

EN

ARROW®

## Single-Lumen Central Venous Catheterization Product

### Safety and Efficacy Considerations:

**Do not use if package has been previously opened or damaged.**

**Warning:** Read all package insert warnings, precautions, and instructions prior to use. Failure to do so may result in severe patient injury or death.

**Do not alter the catheter, spring-wire guide, or any other kit/ set component during insertion, use, or removal.**

**Procedure must be performed by trained personnel well versed in anatomical landmarks, safe technique, and potential complications.**

**Warning: Do not place the catheter into or allow it to remain in the right atrium or right ventricle (refer to Fig. 1).**

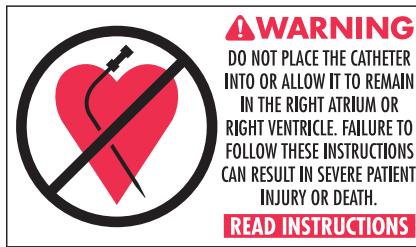


Fig. 1

**Cardiac Tamponade:** It has been documented by many authors that placement of indwelling catheters in the right atrium is a dangerous practice<sup>1,2,3,5,7,13,15</sup> that may lead to cardiac perforation and tamponade<sup>1,2,3,5,13,15</sup>. Although cardiac tamponade secondary to pericardial effusion is uncommon, there is a high mortality rate associated with it<sup>17</sup>. Practitioners placing central venous catheters must be aware of this potentially fatal complication before advancing the catheter too far relative to patient size.

No particular route or catheter type is exempt from this potentially fatal complication<sup>15</sup>. The actual position of the tip of the indwelling catheter should be confirmed by x-ray after insertion<sup>1,2,5,13,15,18</sup>. Central venous catheters should be placed in the superior vena cava<sup>1,2,3,5,7,13,20</sup> above its junction with the right atrium and parallel to the vessel wall<sup>19,20</sup> and its distal tip positioned at a level above either the aygson vein or the carina of the trachea, whichever is better visualized.

Central venous catheters should not be placed in the right atrium unless specifically required for special relatively short term procedures, such as aspiration of air emboli during neurosurgery. Such procedures are nevertheless risk prone and should be closely monitored and controlled.

### Contraindications:

None known.

### Warnings and Precautions:<sup>\*</sup>

1. **Warning:** Sterile, Single use: Do not reuse, reprocess or resterilize. Reuse of device creates a potential risk of serious injury and/or infection which may lead to death.
2. **Warning:** Do not place the catheter into or allow it to remain in the right atrium or right ventricle. Central vein catheters should be positioned so that the distal tip of the catheter is in the superior vena cava (SVC) above the junction of the SVC and the right atrium and lies parallel to the vessel wall. For femoral vein approach, the catheter should be advanced into the vessel so that the catheter tip lies parallel to the vessel wall and does not enter the right atrium.
3. **Warning:** Practitioners must be aware of complications associated with central vein catheters including cardiac tamponade secondary to vessel wall, atrial or ventricular perforation, pleural and mediastinal injuries, air embolism, catheter embolism, thoracic duct laceration, bacteremia, septicemia, thrombosis, inadvertent arterial puncture, nerve damage, hematoma, hemorrhage, and dysrhythmias.
4. **Warning:** Do not apply excessive force in removing guide wire or catheters. If withdrawal cannot be easily accomplished, a chest x-ray should be obtained and further consultation requested.
5. **Warning:** The practitioner must be aware of potential air embolism associated with leaving open needles or catheters in central venous puncture sites or as a consequence of inadvertent disconnects. To lessen the risk of disconnects, only securely tightened Luer-Lock connections should be used with this device. Follow hospital protocol to guard against air embolism for all catheter maintenance.
6. **Warning:** Passage of the guide wire into the right heart can cause dysrhythmias, right bundle branch block,<sup>8</sup> and vessel wall, atrial or ventricular perforation.
7. **Warning:** Due to the risk of exposure to HIV (Human Immunodeficiency Virus) or other blood borne pathogens, health care workers should routinely use universal blood and body-fluid precautions in the care of all patients.
8. **Precaution:** Indwelling catheters should be routinely inspected for desired flow rate, security of dressing, correct catheter position, and for secure Luer-Lock connection. Use centimeter markings to identify if the catheter position has changed.
9. **Precaution:** Only x-ray examination of the catheter placement can ensure that the catheter tip has not entered the heart or no longer lies parallel to the vessel wall. If catheter position has changed, immediately perform chest x-ray examination to confirm catheter tip position.
10. **Precaution:** Alcohol and acetone can weaken the structure of polyurethane materials. Check ingredients of prep sprays and swabs for acetone and alcohol content.

### Indications for Use:

The single-lumen catheter permits venous access to the central circulation.

- Acetone:** Do not use acetone on catheter surface. Acetone may be applied to skin but must be allowed to dry completely prior to applying dressing.
- Alcohol:** Do not use alcohol to soak catheter surface or to restore catheter patency. Care should be taken when instilling drugs containing high concentration of alcohol. Always allow alcohol to dry completely prior to applying dressing.
11. **Precaution:** Some disinfectants used at the catheter insertion site contain solvents, which can attack the catheter material. Assure insertion site is dry before dressing.
  12. **Precaution:** Use of a syringe smaller than 10 mL to irrigate or declog an occluded catheter may cause intraluminal leakage or catheter rupture.<sup>6</sup>

## A Suggested Procedure: Use sterile technique.

1. **Precaution:** Place patient in slight Trendelenburg position as tolerated to reduce the risk of air embolism. If femoral approach is used, place patient in supine position.
2. Prep and drape puncture site as required.
3. Perform skin wheal with desired needle (25 Ga. or 22 Ga. needle).
4. Prepare the catheter for insertion by flushing the lumen. Leave the catheter uncapped for guide wire passage. **Warning:** Do not cut the catheter to alter length.
5. Locate central vein with a 22 Ga. needle and syringe.
6. Insert introducer catheter/needle with attached syringe into vein beside locator needle and aspirate. Remove locator needle. Withdraw needle from introducer catheter. If no free flow of venous blood is observed after needle is removed, attach syringe to the catheter and aspirate until good venous blood flow is established. **Precaution:** The color of the blood aspirated is not always a reliable indicator of venous access.<sup>10</sup> Do not reinsert needle into introducer catheter. Because of the potential for inadvertent arterial placement, verify venous access via a wave form obtained by a calibrated pressure transducer (refer to Fig. 2).




Fig. 2

If hemodynamic monitoring equipment is not available to permit transducing a central venous wave form, disconnect the syringe and check for pulsatile flow. Pulsatile flow is usually an indicator of inadvertent arterial puncture.

### Alternate Technique:

Introducer needle may be used in the standard manner as alternative to catheter/needle assembly.

7. Insert desired tip of spring-wire guide through introducer needle or catheter into vein. If the "J"-tip portion of the spring-wire guide is used, prepare for insertion by sliding the plastic tube over the "J" to straighten. The spring-wire guide should then be advanced in the routine fashion to the desired depth. Advancement of "J" tip may require a gentle rotating motion. **Warning:** Do not cut spring-wire guide to alter length. Do not withdraw spring-wire guide

against needle bevel to minimize the risk of possible severing or damaging of spring-wire guide.

8. Hold spring-wire guide in place and remove introducer needle or catheter. **Precaution:** Maintain firm grip on spring-wire guide at all times.
9. Enlarge cutaneous puncture site with cutting edge of scalpel positioned away from the spring-wire guide. **Precaution:** Do not cut guide wire. Use vessel dilator to enlarge site as required. **Warning:** Do not leave vessel dilator in place as an indwelling catheter to minimize the risk of possible vessel wall perforation.
10. Thread tip of catheter over spring-wire guide. Sufficient guide wire length must remain exposed at hub end of catheter to maintain a firm grip on guide wire. Grasping near skin, advance catheter into vein with slight twisting motion. **Precaution:** If provided, catheter clamp and fastener must not be attached to catheter until spring-wire guide is removed.
11. Advance the catheter to the final indwelling position using centimeter marks (where provided) as positioning reference points.
12. Hold catheter at desired depth and remove spring-wire guide. The Arrow® catheter included in this product has been designed to freely pass over the spring-wire guide. If resistance is encountered when attempting to remove the spring-wire guide after catheter placement, the spring-wire may be kinked about the tip of the catheter within the vessel (refer to Fig. 3).

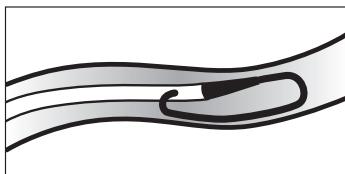


Fig. 3

In this circumstance, pulling back on the spring-wire guide may result in undue force being applied resulting in spring-wire guide breakage. If resistance is encountered, withdraw the catheter relative to the spring-wire guide about 2-3 cm and attempt to remove the spring-wire guide. If resistance is again encountered, remove the spring-wire guide and catheter simultaneously. **Warning:** Although the incidence of spring-wire guide failure is extremely low, practitioner should be aware of the potential for breakage if undue force is applied to the wire.

13. Verify that the entire spring-wire guide is intact upon removal.
14. Check lumen placement by attaching a syringe to catheter and aspirate until free flow of venous blood is observed. Connect appropriate Luer-Lock line, as required, or "lock" through injection cap using standard hospital protocol. Where provided, slide clamp is used on extension line to occlude flow through catheter during line and injection cap changes. **Precaution:** To minimize the risk of damage to extension line from excessive pressure, clamp must be opened prior to infusing through catheter.

15. Secure and dress catheter temporarily.
16. Verify catheter tip position by chest x-ray immediately after placement. **Precaution:** X-ray exam must show the catheter located in the right side of the mediastinum in the SVC with the distal end of the catheter parallel to the vena cava wall and its distal tip positioned at a level above either the azygous vein or the carina of the trachea, whichever is better visualized. If catheter tip is malpositioned, reposition and reverify.
17. Secure catheter to patient. Use integral suture ring and/or side wings as primary suture site. In kits where provided, the catheter clamp and fastener should be utilized as a secondary suture site as necessary. **Precaution:** Do not suture directly to the outside diameter of the catheter to minimize the risk of cutting or damaging the catheter or impeding catheter flow.

#### Catheter Clamp and Fastener (where provided)

##### Instructions for Use:

- After spring-wire guide has been removed and the line has been connected or locked, spread wings of rubber clamp and position on catheter, as required, to ensure proper tip location (refer to Fig. 4).

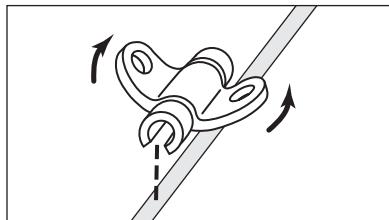


Fig. 4

- Snap rigid fastener onto catheter clamp (refer to Fig. 5).

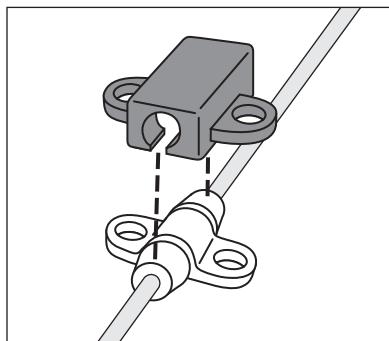


Fig. 5

- Secure catheter to patient by suturing the catheter clamp and fastener to the skin, using side wings to minimize the risk of catheter migration (refer to Fig. 6).

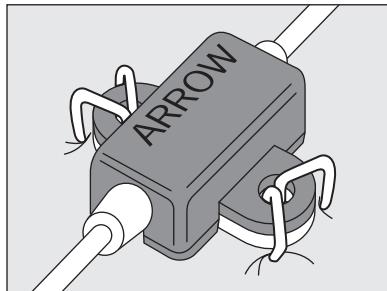


Fig. 6

18. Dress puncture site per hospital protocol. **Precaution:** Maintain the insertion site with regular meticulous redressing using aseptic technique.
19. Record on the patient's chart the indwelling catheter length using centimeter markings (where provided) on catheter where it enters the skin. Frequent visual reassessment should be made to ensure that the catheter has not moved.
20. In kits where provided, a filter straw can be used to withdraw medications from opened ampules.

#### Catheter Exchange Procedure:

1. Use sterile technique.
2. **Precaution:** Prior to attempting a catheter exchange procedure, remove the catheter clamp and fastener, where provided.
3. Proceed per hospital protocol. Cutting the catheter is not recommended due to the potential for catheter embolism.

#### Catheter Removal Procedure:

1. **Precaution:** Place patient in a supine position.
2. Remove dressing. **Precaution:** To minimize the risk of cutting catheter, do not use scissors to remove dressing.
3. **Warning:** Exposure of central vein to atmospheric pressure may result in entry of air into central venous system. Remove suture(s) from catheter clamp, where provided, and primary suture site. Be careful not to cut catheter. Remove catheter slowly, pulling parallel to skin. As catheter exits site, apply pressure with a dressing impermeable to air, e.g. VASELINE®† gauze. Because residual catheter track remains an air entry point until completely sealed, the occlusive dressing should remain in place for at least 24-72 hours dependent upon amount of time catheter was indwelling.<sup>11,14,16,19</sup>
4. Upon removal of catheter, inspect it to make sure entire length has been withdrawn.
5. Document removal procedure.

#### References:

1. Bar-Joseph G, Galvis AG. Perforation of the heart by central venous catheters in infants: guidelines to diagnosis and management. *J Pediatr Surg*. 1983;18:284-287.
2. Blitt CD, ed. *Monitoring in Anesthesia and Critical Care Medicine*. Central venous pressure monitoring. New York, NY: Churchill Livingstone; 1985:121-165.
3. Brandt RL, Foley WJ, Fink GH, Regan WJ. Mechanism of

- perforation of the heart with production of hydropericardium by a venous catheter and its prevention. *Am J Surg*. 1970;119:311-316.
4. Carboni K, Gimenez LF, Rogers WH, Watson AJ. Hemotorax due to vena caval erosion by a subclavian dual-lumen dialysis catheter. *South Med J*. 1987;80:795-796.
  5. Collier PE, Ryan JJ, Diamond DL. Cardiac tamponade from central venous catheters – report of a case and review of the English literature. *Angiology*. September 1984;35:595-600.
  6. Conn C. The importance of syringe size when using implanted vascular access devices. *J Vasc Access Nurs*. Winter 1993;3:11-18.
  7. Curelari J, Linder LE, Gustavsson B. Displacement of catheters inserted through internal jugular veins with neck flexion and extension. *Intens Care Med*. 1980;6:179-183.
  8. Eissa NT, Kvetan V. Guide wire as a cause of complete heart block in patients with preexisting left bundle branch block. *Anesthesiology*. 1990;73:772-774.
  9. Iberti TJ, Katz LB, Reiner MA, Brownie T, Kwun KB. Hydrothorax as a late complication of central venous indwelling catheters. *Surgery*. November 1983;842-846.
  10. Jobes DR, Schwartz AJ, Greenhow DE, Stephenson LW, Ellison N. Safer jugular vein cannulation: recognition of arterial punctures and preferential use of the external jugular route. *Anesthesiology*. 1983;59:353-355.
  11. Kashuk JL, Penn I. Air embolism after central venous catheterization. *Surg Gynecol Obstet*. September 1984;159:249-252.
  12. Kozeny GA, Bansal VK, Vertuno LL, Hano JE. Contralateral hemotorax secondary to chronic subclavian dialysis catheter. *Am J Nephrol*. 1984;4:312-314.
  13. Maschke SP, Rogove HJ. Cardiac tamponade associated with a multilumen central venous catheter. *Crit Care Med*. 1984;12:611-612.
  14. Paskin DL, Hoffman WS, Tuddenham WJ. A new complication of subclavian vein catheterization. *Ann Surg*. March 1974;179:266-268.
  15. Peters JL, ed. *A Manual of Central Venous Catheterization and Parenteral Nutrition*. Boston, MA: John Wright PSG; 1983:58-61,155-157.
  16. Phifer TJ, Bridges M, Conrad SA. The residual central venous catheter track – an occult source of lethal air embolism: case report. *J Trauma*. 1991;31:1558-1560.
  17. Sheep RE, Guiney WB Jr. Fatal cardiac tamponade. *JAMA*. 1982;248:1632-1635.
  18. Sigurdsson J, Riba P, Sigurdsson S. The wandering central venous catheter. *Intensive Care Med*. 1985;11:263-264.
  19. Thielen JB, Nyquist J. Subclavian catheter removal. *J Intravenous Nurs*. March/April 1991;14:114-118.
  20. Tocino IM, Watanabe A. Impending catheter perforation of superior vena cava: radiographic recognition. *Am J Roentgenology*. March 1986;146:487-490.
  21. Vaziri ND, Maksy M, Lewis M, Martin D, Edwards K. Massive mediastinal hematoma caused by a double-lumen subclavian catheter. *Artif Organs*. 1984;8:223-226.
  22. Wanscher M, Frifelt JJ, Smith-Sivertsen C, et al. Thrombosis caused by polyurethane double-lumen subclavian superior vena cava catheter and hemodialysis. *Crit Care Med*. 1988;16:624-628.

Arrow International, Inc. recommends that the user be acquainted with the reference literature.

\*If you have any questions or would like additional reference information, please contact Arrow International, Inc.

<sup>†</sup>A registered trademark of Unilever Supply Chain, Inc.

# Produit de cathétérisme veineux central à lumière unique

## Efficacité et sécurité :

**N'utilisez pas si l'emballage a été endommagé ou est déjà ouvert.**  
**Avertissement : Avant l'utilisation, lisez tous les avertissements ainsi que toutes les mises en garde et les instructions de la notice accompagnant le produit. Le non-respect du mode d'emploi risquerait de causer des blessures graves ou d'entraîner le décès du malade.**

N'altérez pas le cathéter, le fil de guidage métallisé spiralé ou tout autre composant de ce kit/jeu durant l'insertion, l'utilisation ou le retrait du matériel.

La procédure doit être effectuée par un personnel qualifié appliquant une technique sans danger, et faisant preuve d'une excellente connaissance des points de repères anatomiques et des complications potentielles.

**Avertissement : Il ne faut ni placer, ni laisser le cathéter dans l'oreillette ou le ventricule droits (cf. Fig. 1).**

## Tamponade cardiaque :

De nombreux auteurs ont décrit le danger<sup>1,2,3,5,7,13,15</sup> de perforation cardiaque avec tamponade<sup>1,2,3,5,13,15</sup> lors de la mise à demeure d'un cathéter dans l'oreillette droite. Bien qu'une tamponade secondaire à un épanchement dans le péricarde soit chose rare, elle est accompagnée d'un taux de mortalité élevé.<sup>17</sup> Lors du placement de cathétères dans le système veineux central, tout praticien doit se méfier de cette complication potentiellement fatale et juger de l'avancement du cathéter en fonction de la taille du patient.

Une telle complication potentiellement fatale peut survenir avec n'importe quel cathéter et suivant n'importe quelle voie d'accès.<sup>15</sup> Après l'insertion du cathéter à demeure, il faut confirmer la position de son extrémité par radiographie.<sup>1,2,5,13,15,18</sup> Les cathétères pour le système veineux central doivent être placés dans la veine cave supérieure<sup>1,2,3,5,7,10,20</sup> au-dessus de sa jonction avec l'oreillette droite et parallèlement à la paroi vasculaire<sup>9,20</sup> et leur extrémité distale doit être placée juste au-dessus de la veine azygos ou de la carène de la trachée. Choisissez la référence la plus visible.

Ces cathétères pour le système veineux central ne doivent pas être placés dans l'oreillette droite à moins que cette position ne soit requise pour une procédure relativement brève, telle que l'aspiration d'embolie gazeuse lors d'interventions neurochirurgicales. Mais de telles techniques sont néanmoins très risquées et elles doivent être étroitement surveillées et contrôlées.

## Indications d'emploi :

Le cathéter à lumière unique permet un accès veineux à la circulation centrale.

## Contre-indications :

Aucune connue.

## Avertissements et précautions :\*

- Avertissement : Stérile, à usage unique : Ne pas réutiliser, retraiter ou restériliser. La réutilisation du produit crée un risque potentiel de blessure et/ou d'infection grave pouvant causer le décès.**

- Avertissement : Il ne faut ni placer, ni laisser le cathéter dans l'oreillette ou le ventricule droits. Tout cathéter veineux central doit être mis en place de telle manière que son extrémité distale soit dans la veine cave supérieure (VCS) au-dessus de sa jonction avec l'oreillette droite, et qu'il soit parallèle à la paroi vasculaire. Lors d'accès par la veine fémorale, le cathétre doit progresser dans le vaisseau de telle manière que son extrémité soit parallèle à la paroi vasculaire et qu'elle n'entre pas dans l'oreillette droite.**
- Avertissement : Les praticiens doivent être conscients des complications associées aux cathétères veineux centraux, y compris la tamponade cardiaque résultant d'une perforation auriculaire, ventriculaire ou de la paroi vasculaire, les lésions pleurales et médiastinales, l'embolie gazeuse, l'embolie due au cathéter, la laceration du canal thoracique, la bactériémie, la septicémie, les thromboses, la ponction artérielle accidentelle, les lésions nerveuses, les hématomes, l'hémorragie et les dysrythmies.**
- Avertissement : N'appliquez pas une force excessive en retirant le cathéter ou le fil de guidage métallisé spiralé. Si le retrait n'est pas aisée, il faut effectuer une radiographie du thorax et demander des consultations supplémentaires.**
- Avertissement : Le praticien doit être conscient des risques d'embolie gazeuse associés au fait de laisser des aiguilles ou des cathétères ouverts sur des sites de ponction veineuse centrale ou à la suite d'une disjonction accidentelle. Pour diminuer les risques de disjonction, il ne faut utiliser que des raccords de type "Luer-Lock" très bien ajustés avec ce dispositif. Suivez le protocole hospitalier de protection contre les embolies gazeuses lors de l'entretien du cathéter.**
- Avertissement : Le passage d'un fil de guidage métallisé spiralé à travers le cœur droit peut causer des dysrythmies, un bloc de branche droite,<sup>8</sup> et une perforation de l'oreillette, du ventricule ou des parois vasculaires.**
- Avertissement : En raison du risque d'exposition au virus de l'immunodéficience humaine (VIH) ou à d'autres agents pathogènes à diffusion hématogène, le personnel médical doit prendre toutes les mesures de protection indispensables lors de la manipulation de sang ou d'autres fluides corporels, et ceci avec tous les patients.**
- Précaution : En présence de cathétères à demeure, il faut contrôler régulièrement le débit désiré, la sûreté du pansement, la bonne position du cathéter et les raccords Luer-Lock. Utilisez les repères en centimètres pour vérifier la position du cathéter.**
- Précaution : Seule la radiographie peut assurer que l'extrémité du cathéter n'est pas entrée dans le cœur ou qu'elle n'est plus parallèle à la paroi vasculaire. Si le cathéter a changé de position, il faut immédiatement faire une radiographie du thorax pour confirmer la position de son extrémité.**
- Précaution : L'alcool et l'acétone peuvent affaiblir la structure des matériaux en polyuréthane. Vérifiez que les pulvériseurs et les tampons d'ouate utilisés pour la préparation préopératoire ne contiennent pas d'acétone ou d'alcool. Acétone : N'utilisez pas d'acétone sur la surface du cathéter. Il est possible d'appliquer de l'acétone sur la peau, mais il faut la laisser sécher complètement avant d'appliquer un pansement.**

- Alcool : Ne faites pas tremper le cathéter dans de l'alcool et n'utilisez pas d'alcool pour dégager tout blocage du cathéter. Il faut faire très attention lors de l'administration de médicaments contenant une forte concentration d'alcool. Laissez toujours l'alcool sécher complètement avant d'appliquer un pansement.**
- 11. Précaution : Certains désinfectants utilisés sur le site d'insertion du cathéter contiennent des solvants qui peuvent attaquer le matériau du cathéter. Assurez-vous que le site d'insertion est sec avant d'appliquer le pansement.**
- 12. Précaution : L'usage d'une seringue d'un volume inférieur à 10 ml pour irriguer ou débloquer un cathéter obstrué peut entraîner une fuite intraluminale ou une rupture de cathéter.<sup>6</sup>**
- Procédure suggérée :**  
**Utilisez la technique stérile.**
- 1. Précaution : Pour diminuer le risque d'embolie gazeuse, mettre le patient légèrement en position Trendelenburg selon sa tolérance. En cas d'accès par voie fémorale, couchez le patient sur le dos.**
  - Préparer et recouvrir le champ opératoire selon les besoins.
  - Faites une saillie dans la peau avec une aiguille appropriée (aiguille de 25 ou 22 Ga.).
  - Préparez le cathéter en vue de son insertion en lavant la lumière. Laissez le cathéter libre pour permettre le passage du fil de guidage. **Avertissement : Ne coupez pas le cathéter pour en altérer la longueur.**
  - Localisez la veine centrale à l'aide d'une seringue et d'une aiguille de 22 Ga.
  - Insérer le cathéter/l'aiguille d'introduction avec la seringue attachée dans la veine à côté de l'aiguille de positionnement et aspirer. Retirer l'aiguille de positionnement. Retirer l'aiguille du cathéter d'introduction. En cas d'absence d'un reflux de sang veineux après le retrait de l'aiguille, attacher la seringue au cathéter et aspirer jusqu'à l'apparition d'un reflux veineux satisfaisant. **Précaution : La couleur du sang aspiré n'est pas toujours un indicateur fiable de l'accès veineux.<sup>10</sup> Ne pas réinsérer l'aiguille dans le cathéter introduceur.** Vu le danger d'accéder par mésgarde à une artère, il faut vérifier que l'accès soit bien veineux au moyen d'une forme d'onde obtenue par un capteur de pression calibré (cf. Fig. 2).
  - Si un matériel de surveillance hémodynamique n'est pas disponible pour permettre la transduction d'une forme d'onde veineuse centrale, vérifier l'écoulement pulsatile en déconnectant la seringue de l'aiguille. L'écoulement pulsatile est généralement un indicateur de ponction artérielle inadéquate.
  - Autre technique :**  
Une aiguille d'introduction peut être utilisée de façon standard à la place du montage aiguille/cathéter.
  - Insérez la pointe désirée du fil de guidage métallisé spiralé à travers le cathéter ou l'aiguille d'introduction dans la veine. Si l'on utilise le fil de guidage métallisé spiralé avec la pointe en "J", la préparer pour l'insertion en la faisant glisser dans un manchon en plastique pour la redresser. Le fil de guidage métallisé spiralé doit ensuite être avancé jusqu'à la profondeur voulue avec la technique habituelle. Un léger mouvement de rotation peut faciliter la progression de la pointe en "J". **Avertissement : Ne pas couper le fil de guidage métallisé spiralé pour en altérer sa longueur. Pour éviter d'endommager ou de casser le fil de guidage métallisé spiralé, ne pas le retirer contre le biseau de l'aiguille.**
  - Maintenir le fil de guidage métallisé spiralé en place et retirer le cathéter ou l'aiguille d'introduction. **Précaution : Maintenir en permanence une prise ferme sur le fil de guidage métallisé spiralé.**
  - Agrandir le site de la ponction en tenant le tranchant du bistouri éloigné du fil de guidage métallisé spiralé. **Précaution : Ne pas couper le fil de guidage métallisé spiralé.** Utiliser le dilatateur vasculaire pour agrandir le site de ponction suivant les besoins. **Avertissement : Ne pas laisser en place le dilatateur vasculaire en tant que cathéter à demeure vu le danger de perforation de la paroi vasculaire.**
  - Enfilez le bout du cathéter au-dessus du fil de guidage métallisé spiralé. Une longueur suffisante doit rester exposée à l'extrémité garde du cathéter pour permettre de maintenir une prise ferme sur le fil de guidage métallisé spiralé. En le saisissant à proximité de la peau, faire avancer le cathéter dans la veine avec un léger mouvement de torsion. **Précaution : Il ne faut pas raccorder le clamp et l'attache du cathéter, si disponibles, au cathéter avant d'avoir retiré le fil de guidage métallisé spiralé.**
  - Faites avancer le cathéter jusqu'à la position finale voulue en utilisant les marques en centimètre (si disponibles) comme points de référence.
  - Maintenir le cathéter à la profondeur voulue et retirer le fil de guidage métallisé spiralé. Le cathéter Arrow de ce produit a été spécialement conçu pour glisser librement sur le fil de guidage métallisé spiralé. Si, après mise en place du cathéter, il y a résistance lors du retrait du fil de guidage métallisé spiralé, celui-ci peut être entortillé au bout du cathéter dans la voie vasculaire (cf. Fig. 3).
- Dans ce cas, une traction sur le fil de guidage métallisé spiralé avec une force excessive pourrait le briser. En cas de résistance, retirer le cathéter de 2 à 3 cm environ par rapport au fil de guidage métallisé spiralé, puis essayer de retirer le fil de guidage métallisé spiralé. Si la résistance persiste, retirer simultanément le fil de guidage métallisé spiralé et le cathéter. **Avertissement : Bien que l'incidence de défaillances du fil de guidage métallisé spiralé soit extrêmement faible, le praticien doit être au courant du risque de cassure si une force excessive est appliquée sur le fil de guidage métallisé spiralé.**
13. Après le retrait, vérifier que la totalité du fil de guidage métallisé spiralé est intacte.
  - Vérifiez le positionnement correct de la lumière en raccordant une seringue au cathéter et en aspirant jusqu'à l'apparition d'un débit libre de sang veineux. Raccordez la tubulure Luer-Lock appropriée selon les besoins ou « verrouillez » à l'aide du capuchon d'injection en suivant le protocole standard de l'hôpital. Si disponible, un clamp coulissant est utilisé sur la tubulure de rallonge pour arrêter l'écoulement dans le cathéter pendant les changements de tubulures et de capuchons d'injection. **Précaution : Pour minimiser le risque d'endommager la tubulure de rallonge en raison d'une pression excessive, il faut ouvrir le clamp avant la perfusion à travers le cathéter.**
  - Tenir en place et panser le cathéter temporairement.
  - Après la mise en place du cathéter, contrôler immédiatement la position de son extrémité par une radiographie du thorax. **Précaution : L'examen radiologique doit prouver que le cathéter est bien localisé dans le médiastin droit, dans la VCS, avec sa portion distale parallèle à la paroi de la veine cave et son extrémité distale située à un niveau au-dessus soit de la veine aygos, soit de la carène de la trachée (choisir la référence la plus visible).** Si l'extrémité du cathéter n'est pas à l'endroit correct, la repositionner et vérifier à nouveau.

17. Attacher le cathéter au patient. Utilisez l'anneau de suture et/ou les ailes latérales intégrés comme site primaire de suture. Dans les kits où ils sont fournis, il faut utiliser le clamp et l'attache du cathéter comme site de suture secondaire suivant les besoins. **Précaution : Ne pas faire de suture directement sur le diamètre extérieur du cathéter pour éviter de le couper ou de l'endommager, ou de bloquer l'écoulement dans le cathéter.**

**Instructions relatives au clamp et à l'attache du cathéter (s'ils sont fournis) :**

- Après le retrait du fil de guidage métallisé spiralé et le raccordement ou le verrouillage de la ligne, écartez les ailes du clamp en caoutchouc et positionnez-le sur le cathéter comme cela est requis pour assurer une position correcte de l'extrémité (cf. Fig. 4).
  - Forcez l'attache rigide sur le clamp de cathéter (cf. Fig. 5).
  - Assujettissez le cathéter au patient en suturant ensemble le clamp et l'attache du cathéter à la peau, en utilisant des ailes latérales pour réduire au minimum le risque de migration du cathéter (cf. Fig. 6).
18. Faire le pansement du site de la ponction en suivant le protocole hospitalier. **Précaution : Prendre soin du site d'accès en changeant les pansements régulièrement, méticuleusement et stérilement.**
19. Inscrivez dans le dossier du patient la longueur du cathéter introduite, indiquée par les repères en centimètres (si disponibles) sur le cathéter là où il pénètre la peau. Contrôler régulièrement pour s'assurer que le cathéter n'a pas bougé.
20. S'il est fourni avec le kit, un tube à filtre peut être utilisé pour retirer les médications des ampoules ouvertes.

**Procédure de remplacement du cathéter :**

1. Utilisez la technique stérile.
  2. **Précaution : Avant de tenter une procédure de remplacement du cathéter, retirez le clamp et l'attache du cathéter, si disponibles.**
  3. Suivez le protocole hospitalier. Il n'est pas recommandé de couper le cathéter étant donné le risque d'emboîte.
- Procédure de retrait du cathéter :**
1. **Précaution : Couchez le patient sur le dos.**
  2. Retirez le pansement. **Précaution : Pour réduire au minimum le risque de couper le cathéter, n'utilisez pas de ciseau pour retirer les pansements.**
  3. **Avertissement : L'exposition de la veine centrale à la pression atmosphérique peut causer l'entrée d'air dans le système veineux central.** Enlevez la ou les sutures du clamp du cathéter, si disponibles, et du site primaire de suture. Faites attention de ne pas couper le cathéter. Retirez le cathéter lentement, en le tirant parallèlement à la peau. Pendant le retrait du cathéter du site d'insertion, comprimez avec un pansement étanche à l'air, par exemple de la gaze imprégnée de VASELINE. Le canal résiduel laissé par le cathéter étant un point d'entrée pour l'air jusqu'à occlusion complète, le pansement occlusif doit rester en place entre 24 et 72 heures au minimum, selon la durée du séjour du cathéter.<sup>11,14,16,19</sup>
  4. Après le retrait du cathéter, inspectez-le pour vous assurer que toute sa longueur a été retirée.
  5. Documentez le retrait.

Arrow International, Inc. recommande que l'utilisateur se familiarise avec la documentation de référence.

\*Si vous avez des questions ou si vous désirez des ouvrages de référence supplémentaires, veuillez entrer en contact avec Arrow International, Inc.

**FR**

# Katheterisierungsbesteck mit einlumigem zentralen Venenkatheter

## Hinweise zur Sicherheit und Leistungsfähigkeit:

Nicht verwenden, wenn die Packung offen oder beschädigt ist.  
**Warnung:** Vor Gebrauch alle Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und Anleitungen in der Packungsbeilage lesen. Wenn dies nicht getan wird, kann es zu schweren Verletzungen oder zum Tod des Patienten kommen.

Am Katheter, Federführungsdraht sowie anderen Komponenten der Ausstattung/Garnitur dürfen während der Einführung, Verwendung oder Entfernung keinerlei Änderungen vorgenommen werden.

Das Verfahren muß von geschultem Personal, das über die anatomischen Verhältnisse, eine sichere Technik und potentielle Komplikationen informiert ist, durchgeführt werden.

**Warnung:** Katheter nicht im rechten Atrium oder im rechten Ventrikel plazieren oder dort liegen lassen (siehe Abb. 1).

## Herztamponade:

Es wurde von mehreren Autoren dokumentiert, daß die Plazierung eines Verweilkatheters im rechten Atrium gefährlich ist<sup>1,2,3,5,7,13,15</sup> und zu einer kardialen Perforation und Tamponade führen kann.<sup>1,2,3,5,13,15</sup> Eine Herztamponade als Folge eines Perikard-Ergusses ist ungewöhnlich, bringt aber eine hohe Mortalitätsrate mit sich.<sup>17</sup> Ärzte müssen sich beim Legen eines zentralen Venenkatheters dieser potentiell lethalen Komplikation bewußt sein, um den Katheter im Verhältnis zur Größe des Patienten nicht zu weit vorzuschieben.

Diese potentiell tödliche Komplikation kann unabhängig von Zugang und Katheter auftreten.<sup>15</sup> Die endgültige Position der Spitze des Verweilkatheters sollte nach der Einführung mittels Röntgen kontrolliert werden.<sup>1,2,5,13,15,18</sup> Zentrale Venenkatheter sollten in der Vena cava superior<sup>1,2,3,5,7,13,20</sup> über der Einmündung in das rechte Atrium und parallel zur Gefäßwand<sup>9,20</sup> plaziert werden, wobei sich die distale Spitze über der Vena aygos oder der Carina der Trachea, je nachdem was besser sichtbar ist, befinden sollte.

Zentrale Venenkatheter sollten nicht im rechten Atrium plaziert werden, es sei denn, dies wird für bestimmte relativ kurzdauernde Verfahren gewünscht, wie etwa zur Aspiration von Luftembolien bei neurochirurgischen Eingriffen. Diese Anwendungen bergen jedoch ein Risiko in sich und sollten deshalb genau überwacht und kontrolliert werden.

## Indikationen:

Der einlumige Katheter ermöglicht Zugang zu einer Vene und damit zum zentralen Kreislauf.

## Kontraindikationen:

Nicht bekannt.

## Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen:\*

1. **Warnung:** Steril, für den Einmalgebrauch: Nicht wiederverwenden, wiederaufbereiten oder erneut

sterilisieren. Eine Wiederverwendung der Vorrichtung birgt das potentielle Risiko einer schweren Verletzung und/oder Infektion, die zum Tod führen kann.

2. **Warnung:** Katheter nicht im rechten Atrium oder rechten Ventrikel plazieren oder dort liegen lassen. Zentrale Venenkatheter sollten so in der Vena cava superior plaziert werden, daß die distale Spitze des Katheters über der Einmündung in das rechte Atrium und parallel zur Gefäßwand liegt. Bei Zugang über die V. femoralis sollte der Katheter so in das Gefäß vorgeschoben werden, daß seine Spitze parallel zur Gefäßwand liegt und nicht in das rechte Atrium vordringt.
3. **Warnung:** Ärzte müssen über folgende Komplikationen, die beim Legen von zentralen Venenkathetern auftreten können, informiert sein: Herztamponade als Folge einer Gefäßwand-, Atrium- oder Ventrikelperforation, Verletzungen der Pleura bzw. des Mediastinums, Luftembolie, embolische Verschleppung des Katheters, Lazeration des Ductus thoracicus, Bakteriämie, Septikämie, Thrombose, unbeabsichtigte arterielle Punktur, Verletzung von Nerven, Hämatome, Blutungen und Dysrhythmien.
4. **Warnung:** Keine übermäßige Kraft bei der Entfernung von Führungsdrähten und Kathetern anwenden. Falls das Entfernen nicht ohne Schwierigkeiten möglich ist, sollte ein Thoraxröntgen gemacht und das weitere Vorgehen besprochen werden.
5. **Warnung:** Ärzte müssen über die Möglichkeit einer Luftembolie informiert sein, die auftreten kann, wenn Kanülen oder Katheter in zentralvenösen Punktionsstellen offen liegen gelassen werden oder wenn es zu unbeabsichtigten Diskonnektionen kommt. Um das Risiko von Diskonnektionen zu verringern, sollten nur fest angezogene Luer-Lock-Verbindungen mit dieser Vorrichtung verwendet werden. Folgen Sie den in Ihrer Klinik geltenden Richtlinien zur Vermeidung von Luftembolien bei allen Katheterpflegeschriften.
6. **Warnung:** Das Vorschieben des Führungsdrähtes in die rechte Herzhälfte kann zu Rhythmusstörungen, Rechtschenkelblock,<sup>8</sup> sowie Perforationen der Gefäßwand, des Atriums oder des Ventrikels führen.
7. **Warnung:** Da das Risiko einer Infektion mit dem humanen Immunodefizienzvirus (HIV) und anderen durch Blut übertragbaren Keimen besteht, sollte das Personal bei der Pflege aller Patienten immer allgemeine Vorsichtsmaßnahmen im Umgang mit Blut und Körperflüssigkeiten treffen.
8. **Vorsichtsmaßnahme:** Verweilkatheter sollten routinemäßig auf die gewünschte Flußrate, sicheren Verband, korrekte Katheterlage und sichere Luer-Lock-Verbindung untersucht werden. Zentimeter-Markierungen zur Überprüfung der Katheterlage verwenden.
9. **Vorsichtsmaßnahme:** Nur eine Röntgenaufnahme kann mit Sicherheit bestätigen, daß die Katheterspitze nicht im Herzen und parallel zur Gefäßwand liegt. Falls sich die Lage des Katheters verändert, muß die Lage der Katheterspitze sofort mittels Thoraxröntgen überprüft werden.

- 10. Vorsichtsmaßnahme:** Alkohol und Azeton können die Struktur von Polyurethan schwächen. Bestandteile von Sprays zur Vorbereitung der Haut für chirurgische Eingriffe und Tupfern auf Azeton und Alkohol überprüfen. Azeton: Azeton nicht auf eine Katheteroberfläche aufbringen. Azeton kann auf der Haut verwendet werden, muß aber vollständig getrocknet sein, bevor ein Verband angelegt wird.
- Alkohol:** Katheter dürfen nicht in Alkohol eingeweicht werden. Alkohol darf nicht zur Wiederherstellung der Durchgängigkeit eines Katheters verwendet werden. Bei der Verabreichung von Medikamenten, die hochkonzentrierten Alkohol enthalten, sollte besonders vorsichtig vorgegangen werden. Alkohol immer vollständig trocken lassen, bevor ein Verband angelegt wird.
- 11. Vorsichtsmaßnahme:** Manche an der Katheter-Einführungsstelle verwendete Desinfektionsmittel enthalten Lösemittel, die das Material des Katheters angreifen können. Vergewissern Sie sich, daß die Einführungsstelle trocken ist, bevor der Verband angelegt wird.
- 12. Vorsichtsmaßnahme:** Bei Verwendung einer Spritze, die kleiner als 10 ml ist, zur Spülung eines Katheters bzw. zur Entfernung von Blutgerinnseln kann es zu einer intraluminalen Leckage oder Ruptur des Katheters kommen.<sup>6</sup>
- Vorgeschlagenes Vorgehen:  
Eine sterile Technik verwenden.**
- Vorsichtsmaßnahme:** Bringen Sie den Patienten in eine leichte Trendelenburg-Lage, sofern diese toleriert wird, um das Risiko einer Lufthämatomie zu mindern. Beim Zugang über die V. femoralis sollte der Patient auf dem Rücken liegen.
  - Punktionssstelle wie erforderlich vorbereiten und abdecken.
  - Lokalanästhesie mit einer 25-Ga.- bzw. 22-Ga.-Kanüle durchführen.
  - Katheter zur Einführung durch Spülen des Lumens vorbereiten. Katheter zum Einführen des Führungsdrähtes offen lassen. **Warnung: Katheter nicht kürzen.**
  - Vene mit einer Einführungskanüle (22 Ga.) auf einer Spritze aufrufen.
  - Einführungskatheter und Kanüle mit aufgesetzter Spritze in die Vene neben der Pilotenadel einführen und aufziehen. Pilotenadel entfernen. Kanüle vom Einführungskatheter abnehmen. Wenn nach Entfernen der Kanüle kein venöses Blut herausfließt, Spritze am Katheter befestigen und aspirieren, bis venöses Blut sichtbar wird. **Vorsichtsmaßnahme: Die Farbe des aspirierten Blutes ist nicht immer ein zuverlässiges Anzeichen für venösen Zugang.<sup>10</sup> Kanüle nicht nochmals in den Einführungskatheter einsetzen.** Kontrollieren Sie die Plazierung in der Vene anhand der Druckkurve eines geeichten Druckumwandlers, da die Möglichkeit einer versehentlichen Punktation einer Arterie besteht (siehe Abb. 2).

Wenn keine hämodynamischen Vorrangrichtungen zur Aufzeichnung einer Venen-Welle zur Verfügung stehen, sollte die Spritze abgenommen und festgestellt werden, ob der Blutfluß pulsiert. Pulsierender Blutfluß ist in der Regel ein Zeichen für eine unbeabsichtigte arterielle Punktation.

**Alternative Methode:**  
Eine Einführungskanüle kann anstelle der Katheter/Kantile-Baugruppe wie gewöhnlich verwendet werden.

  - Die vorgesehene Spitze des Federführungs-drahtes durch die Einführungskanüle oder den Katheter in die Vene einführen. Falls das J-förmige Ende des Federführungsdrähtes verwendet wird, bereiten Sie diesen zur Einführung vor, indem Sie das Plastikröhrchen über das "J" schieben, um es geradezubiegen.
  - Der Federführungsdräht kann nun auf übliche Weise bis zur gewünschten Stelle eingeführt werden. Das Vorschieben des J-förmigen Endes kann eine leichte Drehbewegung erfordern. **Warnung: Federführungsdräht nicht kürzen. Den Federführungsdräht nicht gegen den Kanülenenschliff herausziehen, um das Risiko eines möglichen Abscherens oder einer Beschädigung des Führungsdrähtes auf ein Minimum herabzusetzen.**
  - Federführungsdräht festhalten und Einführungskanüle oder Katheter entfernen. **Vorsichtsmaßnahme: Führungsdräht während des gesamten Vorgangs gut festhalten.**
  - Punktionssstelle erweitern, wobei die Schnittkante des Skalpells vom Führungsdräht abgewandt gehalten werden muß. **Vorsichtsmaßnahme: Führungsdräht nicht abschneiden.** Gefäßdilatator wie erforderlich zur Erweiterung der Punktionssstelle verwenden. **Warnung: Gefäßdilatator niemals als Verweilkatheter liegen lassen, um das Risiko einer möglichen Gefäßwandperforation auf ein Minimum herabzusetzen.**
  - Spitze des Katheters über den Federführungsdräht fädeln. Am Ansatzstück des Katheters muß ein genügend langer Teil des Führungsdrähtes freibleiben, so daß Sie den Führungsdräht festhalten können. Katheter nahe an der Haut ergreifen und mit leichter Drehbewegung in die Vene vorschieben. **Vorsichtsmaßnahme: Die Katheterklemme und der Katheterhalter (sofern vorhanden) dürfen nicht vor Entfernung des Federführungsdrähtes am Katheter befestigt werden.**
  - Katheter zur gewünschten Verweilposition vorschieben, wobei die Zentimetermarkierungen am Katheter (soweit vorhanden) als Bezugspunkte für die Positionierung verwendet werden.
  - Katheter in gewünschter Stellung festhalten und Federführungsdräht entfernen. Der in diesem Set enthaltene Arrow-Katheter ist so ausgelegt, daß er frei über einen Federführungsdräht geführt werden kann. Falls Sie beim Entfernen des Federführungsdrähtes nach der Katheterplazierung auf Widerstand treffen, kann der Führungsdräht innerhalb des Gefäßes an der Spitze des Katheters verbogen sein (siehe Abb. 3). Unter diesen Umständen kann der Federführungsdräht beim Zurückziehen mit übermäßiger Kraftaufwendung reißen. Falls ein Widerstand auftaucht, Katheter relativ zum Federführungsdräht 2-3 cm zurückziehen und nochmals versuchen, den Federführungsdräht zu entfernen. Falls Sie immer noch auf Widerstand treffen, müssen Federführungsdräht und Katheter gleichzeitig entfernt werden. **Warnung: Obwohl der Federführungsdräht äußerst selten reißt, muß der Arzt darüber informiert sein, daß der Führungsdräht abreissen kann, wenn er übermäßiger Kraftaufwendung ausgesetzt wird.**
  - Stellen Sie sicher, daß der Federführungsdräht in seiner Gesamtheit unbeschädigt herausgezogen.
  - Platzierung im Lumen überprüfen, indem am Katheter eine Spritze angesetzt und aspiriert wird, bis frei fließendes venöses Blut sichtbar wird. Entsprechende Luer-Lock-Leitung wie erforderlich anschließen oder unter Verwendung krankenhausüblicher Methoden durch eine Spritzenkappe „verriegeln“. Wenn vorhanden, wird eine verschließbare Klemme am Verlängerungsschlach verwendet, um den Fluss durch den Katheter während eines Leitungs- oder Spritzenkappentausches zu unterbrechen. **Vorsichtsmaßnahme: Um das Risiko einer Schädigung der Verlängerungsschlüsse durch übermäßigen Druck auf ein Minimum herabzusetzen, muss jede Klemme vor einer Infusion durch das entsprechende Lumen geöffnet werden.**

15. Katheter vorübergehend fixieren und Verband anlegen.
  16. Überprüfen Sie bitte die Position der Katheterspitze mittels Röntgen unmittelbar nach der Plazierung. **Vorsichtsmaßnahme:** Die Röntgenuhnahme muß bestätigen, daß der Katheter auf der rechten Seite des Mediastinums in der V. cava superior liegt, wobei sich das distale Ende des Katheters parallel zur Wand der Vena cava und die distale Spitze entweder über der V. azygos oder der Carina der Trachea befinden soll, je nachdem was besser sichtbar ist. Wenn sich die Katheterspitze nicht an der richtigen Stelle befindet, diese neu plazieren und wieder überprüfen.
  17. Katheter am Patienten fixieren. Eingebauten Nahtring und/oder Seitenflügel für die Primärnaht verwenden. Soweit zur Garnitur gehörig, sollten die Katheterklemme und der Katheterhalter zum Anlegen einer Sekundärnaht verwendet werden, falls eine solche erforderlich ist. **Vorsicht:** Nähte nicht an der Außenseite des Katheters anlegen, um das Risiko von Einstichen oder Beschädigungen auf ein Minimum herabzusetzen und den Durchfluß nicht zu behindern.
- Anleitungen für die Katheterklemme und den Katheterhalter (falls mitgeliefert):**
- Nach Entfernung des Federführungsdrähtes und Verbindung oder Verschluß der Leitung Flügel der Gummiklemme ausbreiten und am Katheter entsprechend platzieren, um eine richtige Plazierung der Spitze sicherzustellen (siehe Abb. 4).
  - Unbigsamen Halter auf der Katheterklemme einrasten lassen (siehe Abb. 5).
  - Katheter am Patienten durch Annähen der Katheterklemme und des Katheterhalters an der Haut fixieren, wobei die Seitenflügel verwendet werden, um das Risiko einer Kathetermigration auf ein Minimum herabzusetzen (siehe Abb. 6).
18. Punktionsstelle nach den in Ihrer Klinik geltenden Richtlinien verbinden. **Vorsichtsmaßnahme: Punktionsstelle regelmäßig aseptisch verbinden.**
  19. Die eingeführte Länge des Katheters mithilfe der auf dem Katheter befindlichen Zentimeter-Markierungen (soweit vorhanden) an der Eintrittsstelle in die Haut ermitteln und im Krankenblatt des Patienten vermerken. Häufige Sichtkontrollen sind notwendig, um sicherzustellen, daß der Katheter nicht verschoben wurde.
  20. Soweit zur Garnitur gehörig, kann ein Filterröhrenchen verwendet werden, um Medikamente aus offenen Ampullen abzusaugen.

### Katheterwechsel:

1. Eine sterile Technik verwenden.
2. **Vorsichtsmaßnahme: Katheterklemme und Katheterhalter, falls vorhanden, vor einem Katheterwechsel entfernen.**
3. Folgen Sie den in Ihrer Klinik geltenden Richtlinien. Ein Abschneiden des Katheters wird aufgrund der Gefahr einer embolischen Verschleppung des Katheters nicht empfohlen.

### Katheterentfernung:

1. **Vorsichtsmaßnahme: Bringen Sie den Patienten in Rückenlage.**
  2. Verband entfernen. **Vorsichtsmaßnahme: Zur Entfernung des Verbandes sollte keine Schere verwendet werden, um das Risiko eines Ein- oder Durchschneidens des Katheters auf ein Minimum herabzusetzen.**
  3. **Warnung: Die Einwirkung von atmosphärischem Druck auf eine punktierte Vene kann zum Eindringen von Luft in das venöse System führen.** Naht/Nähte von der Katheterklemme (sofern verwendet) und der primären Nahtstelle entfernen. Der Katheter darf nicht ab- oder durchgeschnitten werden. Katheter langsam entfernen, wobei er parallel zur Haut herausgezogen werden soll. Beim Austreten des Katheters über Sie mit einem luftundurchlässigen Verband (z.B. Verbandmull mit VASELINE) Druck auf die Punktionsstelle aus. Da der Tunnel des Katheters eine Pforte für Lufteintritt bleibt, bis er vollständig verschlossen ist, sollte der abdichtende Verband mindestens 24-72 Stunden, abhängig von der Verweildauer des Katheters, liegen bleiben.<sup>11,14,16,19</sup>
  4. Nach der Katheterentfernung sicherstellen, daß er in seiner ganzen Länge entfernt wurde.
  5. Entfernung des Katheters dokumentieren.
- Arrow International, Inc. empfiehlt dem Benutzer, die angegebene Literatur zu lesen.
- \*Wenn Sie Fragen haben oder zusätzliche Literaturangaben wünschen, wenden Sie sich bitte an Arrow International, Inc.

## Prodotto a lume singolo per cateterismo della vena centrale

### Considerazioni in merito alla sicurezza ed all'efficacia:

Non usare se la confezione è stata aperta o manomessa. **Avvertenza:** prima dell'uso, leggere tutte le avvertenze, precauzioni e istruzioni stampate nel foglietto illustrativo. La mancata osservanza di tali avvertenze, precauzioni e istruzioni potrebbe comportare gravi lesioni al paziente, e persino provocarne la morte.

Non alterare il catetere, la guida metallica a molla o qualsiasi altro componente del kit/set durante l'inserimento, l'uso o la rimozione.

La procedura deve essere effettuata da personale addestrato, molto esperto nei punti di riferimento anatomici, sicuro nella tecnica ed in grado di affrontare eventuali complicazioni.

**Avvertenza:** non inserire il catetere nell'atrio destro o nel ventricolo destro né lasciarlo inserito (fare riferimento alla Fig. 1).

### Tamponamento cardiaco:

è stato documentato in molti articoli scientifici di autori diversi che l'introduzione di cateteri permanenti nell'atrio destro è una pratica pericolosa<sup>1,2,3,5,7,13,15</sup> che può provocare perforazione e tamponamento cardiaco.<sup>1,2,3,5,13,15</sup> Sebbene il tamponamento cardiaco causato da effusione pericardica sia inconsueto, è tuttavia associato ad un alto tasso di mortalità.<sup>17</sup> I medici che eseguono l'inserimento dei cateteri nella vena centrale devono essere a conoscenza di questa complicazione potenzialmente fatale prima di far avanzare troppo il catetere in relazione alla corporatura del paziente.

Non esistono particolari percorsi o tipi di catetere che possano garantire l'assenza di questa complicazione potenzialmente fatale.<sup>15</sup> La posizione effettiva della punta del catetere permanente deve essere confermata mediante radiografia dopo l'inserimento.<sup>1,2,5,13,15,18</sup> I cateteri per vena centrale devono essere collocati nella vena cava superiore<sup>1,2,3,5,7,13,20</sup> sopra la congiunzione della stessa con l'atrio destro e parallelamente alle pareti del vaso<sup>9,20</sup> in modo che la punta distale si trovi ad un livello superiore rispetto alla vena azygos o alla carena tracheale, scegliendo quella che è maggiormente in evidenza.

I cateteri per vena centrale non vanno collocati nell'atrio destro, a meno che non sia specificamente richiesto per particolari procedure a termine relativamente breve, come ad esempio, l'aspirazione di emboli gassosi durante interventi neurochirurgici. Simili procedure sono nondimeno rischiose e devono essere rigorosamente monitorate e controllate.

### Indicazioni per l'uso:

Il catetere a lume singolo consente l'accesso venoso alla circolazione centrale.

### Controindicazioni:

Nessuna nota.

### Avvertenze e precauzioni:\*

1. **Avvertenza:** Sterile, monouso: non riutilizzare, ricondizionare o risterilizzare. Il riutilizzo del dispositivo crea un rischio potenziale di gravi lesioni e/infezioni che possono risultare fatali.
2. **Avvertenza:** non inserire il catetere nell'atrio destro o nel ventricolo destro né lasciarlo inserito. I cateteri per vena centrale devono essere posizionati in modo tale che la punta distale del catetere si trovi nella vena cava superiore (VCS), sopra la congiunzione della VCS con l'atrio destro, e che giaccia parallela alle pareti del vaso. Per l'inserimento attraverso la vena femorale, il catetere deve essere fatto avanzare nel vaso in modo tale che la punta giaccia parallela alle pareti del vaso e non entri nell'atrio destro.
3. **Avvertenza:** i medici devono essere a conoscenza delle complicazioni associate all'uso dei cateteri per vena centrale, inclusi tamponamento cardiaco dovuto alla perforazione delle pareti del vaso, perforazione atriale o ventricolare, lesioni pleuriche o mediastiniche, embolia gassosa, embolia da catetere, lacerazione del dotto toracico, batteriemia, setticemia, trombosi, involontaria puntura dell'arteria, lesioni ai nervi, ematoma, emorragia e disritmie.
4. **Avvertenza:** non esercitare forza eccessiva durante la rimozione della guida metallica o dei cateteri. Se la rimozione non potesse essere facilmente compiuta, si dovrà eseguire una radiografia toracica e richiedere un ulteriore consulto.
5. **Avvertenza:** il medico deve essere a conoscenza della possibilità di embolia gassosa associata all'avere lasciato aperti aghi o cateteri nei siti di iniezione nella vena centrale o come conseguenza di collegamenti involontari. Per ridurre il rischio di scollegamenti, con questo dispositivo usare esclusivamente connessioni a blocco Luer strettamente serrate. Attenersi al protocollo ospedaliero onde evitare il rischio di embolia gassosa per tutte le procedure di manutenzione del catetere.
6. **Avvertenza:** il passaggio della guida metallica nella parte destra del cuore può causare disritmie, blocco di branca destra<sup>a</sup> e perforazione della parete dei vasi, degli atri o dei ventricoli.
7. **Avvertenza:** a causa del rischio di esposizione all'HIV (Virus dell'immunodeficienza umana) o ad altri agenti patogeni a trasmissione ematica, il personale sanitario deve abitualmente attenersi alla prassi universale riguardo le precauzioni per sangue e fluidi biologici nella cura di tutti i pazienti.
8. **Precauzione:** i cateteri permanenti devono essere regolarmente ispezionati per verificare che la portata sia quella desiderata, che la medicazione sia ben applicata, che il catetere sia posizionato correttamente e che le connessioni a blocco Luer siano sicure. Usare le tacche dei centimetri per controllare se la posizione del catetere sia cambiata.
9. **Precauzione:** soltanto mediante esame radiografico dell'ubicazione del catetere ci si può assicurare che l'estremità del catetere non sia entrata nel cuore o che non

giaccia parallelamente alla parete del vaso. Qualora la posizione del catetere sia mutata, eseguire immediatamente un esame radiografico al torace per confermare la posizione della punta del catetere.

- 10. Precauzione:** l'alcool e l'acetone possono indebolire la struttura dei materiali in poliuretano. Leggere l'elenco degli ingredienti dei prodotti spray e dei tamponi impiegati per la preparazione del paziente per verificare che non contengano acetone o alcool.

Acetone: non impiegare acetone sulla superficie del catetere. L'acetone può essere applicato alla cute, ma deve essere lasciato asciugare completamente prima di applicare la fasciatura.

Alcool: non impiegare alcool per bagnare la superficie del catetere né per rendere nuovamente pervio il catetere. È necessario prestare particolare attenzione durante l'instillazione di farmaci contenenti alte concentrazioni di alcool. Lasciare sempre asciugare completamente l'alcool prima di applicare la fasciatura.

- 11. Precauzione:** alcuni disinfettanti usati sul sito di inserimento del catetere contengono solventi, che possono intaccare il materiale del catetere. Prima di applicare la fasciatura, accertarsi che il sito di inserimento sia asciutto.

- 12. Precauzione:** l'uso di una siringa di misura inferiore a 10 ml per irrigare o liberare da coaguli un catetere occluso potrebbe causare una perdita intraluminale o la rottura del catetere.<sup>6</sup>

## Procedura suggerita:

### Usare una tecnica sterile.

- 1. Precauzione:** sistemare il paziente in posizione di Trendelenburg fino al punto tollerato per ridurre il rischio di embolia gassosa. Se si usa l'approcio femorale, sistemare il paziente in posizione supina.

2. Preparare e coprire il sito d'iniezione come necessario.  
3. Eseguire un'incisione cutanea con l'ago del diametro desiderato (ago di calibro da 25 o 22 Ga.).  
4. Preparare il catetere per l'inserimento sciacquando il lume. Lasciare stappato il catetere per il passaggio della guida metallica. **Avvertenza: non tagliare il catetere per modificarne la lunghezza.**

5. Individuare la vena centrale mediante un ago da 22 Ga. e una siringa.  
6. Introdurre nella vena, accanto all'ago localizzatore, il catetere introduttore/ago con la siringa collegata ed aspirare. Rimuovere l'ago localizzatore. Ritirare l'ago dal catetere introduttore. Se dopo aver rimosso l'ago non si osserva alcun flusso libero di sangue venoso, collegare la siringa al catetere e aspirare finché non si stabilisce un buon flusso di sangue venoso. **Precauzione: il colore del sangue aspirato non è sempre un indicatore affidabile dell'accesso in vena.<sup>10</sup> Non reinserire l'ago nel catetere introduttore.** A causa del rischio di un possibile inserimento involontario del catetere nell'arteria, per verificare l'effettivo inserimento in vena, controllare l'accesso in vena per mezzo di una forma d'onda ottenuta tramite un trasduttore di pressione calibrato (fare riferimento alla Fig. 2).

Qualora non si abbiano a disposizione apparecchiature di monitoraggio emodinamico per effettuare la traduzione di una forma d'onda venosa centrale, verificare la presenza del flusso pulsatile scollegando la siringa. La presenza di flusso pulsatile indica solitamente che l'ago è stato inavvertitamente inserito in un'arteria.

### Tecnica alternativa:

L'ago introduttore può essere usato nella maniera standard come alternativa al gruppo catetere/ago.

7. Inserire l'estremità desiderata della guida metallica a molla nella vena attraverso l'ago o catetere introduttori. Se si usa la parte della guida metallica a molla con punta a "J", prepararla per l'inserimento facendo scorrere il tubo di plastica sulla "J", per raddrizzarla. La guida metallica a molla deve poi essere fatta avanzare nel modo consueto fino alla profondità desiderata. Per far avanzare la punta a "J" potrebbe essere necessario un lieve movimento rotatorio. **Avvertenza: non tagliare la guida metallica a molla per modificarne la lunghezza. Non ritrarre la guida metallica a molla contro la smussatura dell'ago per ridurre al minimo il rischio di tagliare o danneggiare la guida stessa.**  
8. Mantenere in posizione la guida metallica a molla e rimuovere l'ago introduttore o il catetere introduttore. **Precauzione: mantenere una salda presa sulla guida metallica a molla per l'intera durata dell'operazione.**  
9. Allargare il sito cutaneo dell'iniezione tenendo il bordo tagliente del bisturi posizionato lontano dalla guida metallica a molla. **Precauzione: non tagliare la guida metallica.** Usare un dilatatore per vasi per allargare il sito (d'iniezione) come necessario. **Avvertenza: non lasciare inserito il dilatatore come se si trattasse di un catetere permanente per ridurre al minimo il rischio di perforare la parete dei vasi.**  
10. Infilare la punta del catetere sopra la guida metallica a molla. Per mantenere una salda presa sulla guida metallica è necessario che un tratto sufficiente di guida rimanga al di fuori dell'estremità del raccordo del catetere. Afferrandolo vicino alla cute, far avanzare il catetere nella vena con lieve movimento rotatorio. **Precauzione: collegare il morsetto ed il fermo (dove forniti) al catetere soltanto dopo aver rimosso la guida metallica a molla.**  
11. Far avanzare il catetere fino alla definitiva posizione permanente servendosi delle tacche dei centimetri (se presenti) come punti di riferimento per la collocazione dello stesso.  
12. Mantenere il catetere alla profondità desiderata e rimuovere la guida metallica a molla. Il catetere Arrow in dotazione con questo prodotto è stato progettato per passare liberamente sulla guida metallica a molla. Qualora si incontrasse resistenza durante il tentativo di rimozione della guida metallica a molla in seguito all'inserimento del catetere, la guida metallica potrebbe essere rimasta agganciata all'estremità del catetere all'interno del vaso (fare riferimento alla Fig. 3).  
In tale circostanza, tirando la guida metallica a molla può capitare di esercitare una forza eccessiva e provocarne la rottura. Se si incontra resistenza, ritirare il catetere di 2-3 cm rispetto alla guida metallica e tentare quindi di estrarre la guida metallica. Se si incontra nuovamente resistenza, estrarre contemporaneamente la guida metallica ed il catetere. **Avvertenza: sebbene l'incidenza di rottura della guida metallica a molla sia estremamente bassa, il medico dev'essere consapevole del rischio di rottura della guida qualora venga esercitata una forza eccessiva sul filo metallico.**  
13. Una volta rimossa la guida metallica, verificare che sia intatta.  
14. Controllare il posizionamento del lume collegando una siringa al catetere ed aspirando fino a quando si stabilisce un buon flusso di sangue venoso. Collegare un tubo a blocco Luer, come necessario, oppure "blockare" con un cappuccio di iniezione, attendendo al protocollo ospedaliero standard. Laddove fornito, il morsetto scorrevole viene usato sul tubo di prolunga per occludere il

- flusso attraverso il catetere durante la sostituzione del tubo e del cappuccio di iniezione. **Precauzione: per ridurre al minimo il rischio di danni ai tubi di prolunga a causa di una pressione eccessiva, occorre aprire ciascun morsetto prima di procedere all'infusione attraverso il catetere.**
15. Fissare temporaneamente il catetere ed applicare una fasciatura.
16. Verificare la posizione della punta del catetere mediante una radiografia toracica subito dopo l'inserimento. **Precauzione: l'esame radiografico deve mostrare il catetere collocato nel lato destro del mediastino nella VCS, con l'estremità distale del catetere parallela alla parete della vena cava e la punta distale posizionata ad un livello superiore rispetto alla venaazygos o alla carena tracheale, scegliendo quella che è maggiormente in evidenza.** Se la punta del catetere non è posizionata correttamente, riposizionarla e ripetere la verifica.
17. Fissare il catetere al paziente. Come sito primario di suturazione usare l'anello di sutura e/o le alette laterali incorporati. Nei kit che li prevedono, il morsetto ed il fermo del catetere possono essere impiegati come sito di sutura secondario, qualora sia necessario. **Precauzione: non suturare direttamente sul diametro esterno del catetere per ridurre al minimo il rischio di tagliare o danneggiare il catetere e per non impedire il flusso.**
- Istruzioni per l'uso del morsetto e del fermo del catetere (laddove forniti):**
- Dopo aver estratto la guida metallica a molla e collegato o bloccato le linee pertinenti, allargare le alette del morsetto in gomma e collocarlo sul catetere come necessario, per assicurare il corretto posizionamento della punta (fare riferimento alla Fig. 4).
  - Fissare con uno scatto il fermo rigido sul morsetto del catetere (fare riferimento alla Fig. 5).
  - Fissare il catetere al paziente suturando insieme il morsetto ed il fermo del catetere alla cute e usando le alette laterali per ridurre al minimo il rischio che il catetere possa spostarsi (fare riferimento alla Fig. 6).
18. Medicare il sito d'iniezione attenendosi al protocollo ospedaliero. **Precauzione: applicare regolarmente nuove medicazioni al sito di inserimento, usando sempre una tecnica asettica.**
19. Annotare sulla cartella del paziente la lunghezza del catetere permanente utilizzando come punto di riferimento, se presenti,
- le tacche dei centimetri nel punto in cui il catetere penetra la cute. È necessario ricontrizzare frequentemente tali tacche per assicurarsi che il catetere non si sia mosso.
20. Nei kit che lo prevedono, adoperare una cannuccia filtrante per prelevare i farmaci dalle fiale aperte.

### **Procedura per il cambio del catetere:**

1. Usare una tecnica sterile.
2. **Precauzione: prima di sostituire un catetere, rimuovere il morsetto ed il fermo del catetere (se presenti).**
3. Procedere attenendosi al protocollo ospedaliero. Si raccomanda di non tagliare il catetere a causa del rischio di embolia dovuta all'uso del catetere.

### **Procedura di rimozione del catetere:**

1. **Precauzione: sistemare il paziente in posizione supina.**
2. Togliere la medicazione. **Precauzione: per ridurre al minimo il rischio di tagliare il catetere, non usare forbici per rimuovere la medicazione.**
3. **Avvertenza: l'esposizione della vena centrale alla pressione atmosferica può causare introduzione di aria nel sistema venoso centrale.** Rimuovere la/le sutura/e dal morsetto del catetere, se pertinente, e dal sito primario di sutura. Fare attenzione a non tagliare il catetere. Estrarre il catetere lentamente, mantenendolo parallelo alla cute. Durante l'uscita del catetere dal sito di introduzione, esercitare pressione con una fasciatura impermeabile all'aria, quale ad esempio una garza imbevuta di VASELINE. Poiché il tratto di catetere residuo può rappresentare un punto per l'ingresso di aria fino a quando non sia stato completamente sigillato, la fasciatura oclusiva deve essere tenuta in sito per almeno 24-72 ore, a seconda del periodo di tempo che il catetere è rimasto nel corpo.<sup>11,14,16,19</sup>
4. Dopo aver rimosso il catetere, controllarlo per assicurarsi che sia stato estratto interamente.
5. Annotare la procedura usata per la rimozione.

La Arrow International, Inc. consiglia ai medici di familiarizzarsi con le opere scientifiche appropriate.

\*In caso di quesiti o per ulteriori informazioni su questo argomento, rivolgersi alla Arrow International, Inc.

## Jednokanałowy cewnik do żył centralnych

### Kwestie bezpieczeństwa i efektywności:

Nie używać, jeśli opakowanie zostało wcześniej uszkodzone lub otwarte. **Ostrzeżenie:** Przed użyciem zapoznać się ze wszystkimi uwagami, środkami ostrożności i instrukcjami zawartymi w ulotce dołączonej do opakowania. Niespełnienie tego zalecenia może spowodować ciężkie obrażenia lub zgon pacjenta.

Podczas wprowadzania, używania i wyjmowania nie wolno modyfikować cewnika, prowadnika sprężynowego ani innych części zestawu.

Zabieg musi wykonać przeszkolony personel znający dobrze anatomię, bezpieczne techniki i potencjalne powiklania.

**Ostrzeżenie:** Cewnika nie wolno umieszczać ani pozostawiać w prawym przedsięciu lub prawej komorze serca (patrz rys 1).

### Tamponada serca:

Jak wykazało wielu autorów, umieszczanie cewników w prawym przedsięciu jest niebezpieczną praktyką.<sup>1,2,3,5,7,13,15</sup> Któż może prowadzić do perforacji serca i tamponady.<sup>1,2,3,5,13,15</sup> Choć tamponada serca w wyniku wysiłku osiedziowego jest rzadka, towarzyszy jej wysoki współczynnik śmiertelności.<sup>17</sup> Lekarze umieszczający cewniki w zylach centralnych muszą zdawać sobie sprawę z potencjalnie śmiertelnych powikłań posunięcia cewnika zbyt daleko w stosunku do rozmarów pacjenta.

Żadna droga dostępu ani typ cewnika nie jest wolny od tego potencjalnie śmiertelnego powiklania.<sup>15</sup> Rzeczywiście położenie końcówek założonego cewnika należy potwierdzić zdjęciem rentgenowskim po wprowadzeniu go.<sup>1,2,5,13,15,18</sup> Cewniki do żył centralnych należy umieszczać w zyle głównej górnjej<sup>1,2,3,5,7,13,20</sup> nad jej połączeniem z prawym przedsięciem i równolegle do ściany naczynia,<sup>20</sup> a dystalna końcówka cewnika powinna się znajdować powyżej żyły nieparzystej albo ostożki tchawicy, zależnie od tego, co można lepiej zobrazować.

Cewników do cewnikowania żył centralnych nie należy umieszczać w prawym przedsięciu, chyba że wymaga tego konkretnie stosunkowo krótkotrwały zabieg, tak jak wessanie zatoru powietrznego podczas operacji neurochirurgicznej. Procedury takie są mimo wszystko ryzykowne, wymagają ścisłego monitorowania i kontroli.

### Wskazania:

Cewnik jednokanałowy umożliwia dostęp zylny do krążenia centralnego.

### Przeciwskazania:

Nie są znanego.

### Ostrzeżenia i uwagi:<sup>\*</sup>

- Ostrzeżenie: Sterylny, do jednorazowego użytku: Nie wolno używać ponownie, poddawać ponownym procesom ani ponownej sterylizacji. Ponowne użycie urządzeń stwarza możliwość poważnego obrażenia i/lub zakazienia, co może spowodować śmierć.

**2. Ostrzeżenie:** Cewnika nie wolno umieszczać ani pozostawiać w prawym przedsięciu lub prawej komorze serca. Cewniki do żył centralnych należy umieszczać w taki sposób, aby dystalna końcówka cewnika znajdowała się w górnjej zyle głównej (superior vena cava, SVC) powyżej połączenia SVC i prawego przedsięciu oraz tak, aby leżała równolegle do ściany naczynia. Przy dostępie z zły udowej cewnik należy wprowadzać w naczynie w taki sposób, aby końcówka cewnika była umieszczona równolegle do ściany naczynia i żeby nie weszła do prawego przedsięciu.

**3. Ostrzeżenie:** Lekarze muszą być świadomi możliwych powikłań związanych z cewnikami do żyły centralnej, takich jak tamponada serca wywołana perforacją ściany naczynia, przedsięciu lub komory, urazy opuchnięte i śródpiersia, zator powietrny lub zator spowodowany cewnikiem, pokaleczenie przewodu piersiowego, bakteremia, posocznica, zakrzepica, przypadkowe naklucie tlenicy, uszkodzenie nerwu, krwiak, krvotok i zaburzenia rytmu.

**4. Ostrzeżenie:** Nie wolno stosować nadmiernej siły do wyjmowania prowadnika i cewników. Jeżeli wycyfrowanie sprawią trudności, należy uzyskać zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej i zlecić dalsze konsultacje.

**5. Ostrzeżenie:** Lekarz musi zdawać sobie sprawę z możliwości zatoru powietrznego w związku z pozostawieniem w miejscach wkładu do żył centralnych otwartych igiel lub cewników, lub w wyniku nieumyślnych rozłączeń. Aby zmniejszyć ryzyko rozłączeń, w urządzeniu należy stosować jedynie mocno bezpieczne zaciśnięcie połączenia typu Luer-Lock. Należy stosować się do protokołu szpitala aby zapobiec powstawaniu zatorów powietrznych podczas wszelkiej pielęgnacji cewnika.

**6. Ostrzeżenie:** Wprowadzenie prowadnika do prawego serca może wywołać dysrytmie, blok refleks odnogi pęczka Hisa<sup>8</sup> oraz perforację ściany naczynia, przedsięciu lub komory.

**7. Ostrzeżenie:** W związku z niebezpieczeństwami kontaktu z wirusem HIV (ludzkim wirusem niedoboru odporności) lub innymi patogenami przenoszonymi z krwią, w czasie opieki nad wszystkimi pacjentami pracownicy służby zdrowia powinni rutynowo stosować uniwersalne środki bezpieczeństwa przy obchodzeniu się z krwią i płynami ustrojowymi.

**8. Przestroga:** Cewniki założone powinny być okresowo sprawdzane pod kątem żądanej prędkości przepływu, zamocowania opatrunku, prawidłowego położenia cewnika i szczelnego połączenia złączeniem Luer-Lock. Należy użyć oznaczeń centymetrowych, aby ustalić, czy cewnik się nie przemieszcza.

**9. Przestroga:** Jedynie zdjęcie rentgenowskie cewnika może potwierdzić, iż końcówka cewnika nie została umieszczona w sercu bądź też nie przestała być równoległa do ściany naczynia. Jeżeli położenie cewnika uległo zmianie, należy natychmiast wykonać badanie rentgenowskie klatki piersiowej, aby potwierdzić położenie końcówek cewnika.

**10. Przestroga:** Alkohol i acetona mogą osłabić strukturę materiałów z poliuretanu. Należy sprawdzić skład środków rozpylanych do przygotowywania pola operacyjnego oraz środków do nasączenia wacióków pod kątem zawartości acetenu i alkoholu.

- Aceton:** Nie wolno stosować acetonu na powierzchni cewnika. Aceton można stosować na skórze, lecz musi on całkowicie wyschnąć przed nałożeniem opatrunku.
- Alkohol:** Nie wolno używać alkoholu do namaczań powierzchni cewnika ani do przywracania drożności cewnika. Należy zachować ostrożność przy podawaniu leków zawierających wysokie stężenie alkoholu. Przed nałożeniem opatrunku należy zawsze poczekać, aż alkohol całkiem wyschnie.
- 11. Przestroga:** Niektóre środki dezynfekcyjne stosowane w miejscu wprowadzenia cewnika zawierają rozpuszczalniki mogące uszkodzić materiał, z którego wykonany jest cewnik. Przed nałożeniem opatrunku należy się upewnić, iż miejsce wprowadzenia cewnika jest suche.
- 12. Przestroga:** Zastosowanie strzykawki mniejszej niż 10 ml do przepłukiwania zatkanego cewnika lub usuwania z niego skrzepu może spowodować przeciek wewnętrzny światła cewnika lub rozerwanie go.<sup>6</sup>
- ### Sugerowany przebieg zabiegu: Stosować zasady aseptyki.
- Przestroga:** Ułóż pacjenta nieco w pozycji Trendelenburga, jeżeli ją toleruje, aby uniknąć zatoru powietrznego. Przy położeniu się dojściem udowym, należy ułożyć pacjenta na plecach.
  - Przygotować i obłożyć odpowiednio miejsce wkłucia.
  - Wykonać bąbel na skórze odpowiednią igłą (rozmiar 25 G lub 22 G).
  - Przygotować cewnik do wprowadzenia przepłukując światło kanału. Pozostawić cewnik bez nasadki celem przeprowadzenia prowadnika. **Ostrzeżenie:** Nie wolno odcinać cewnika, aby zmienić jego długość.
  - Zlokalizować żylę centralną za pomocą igły o rozmiarze 22 G i strzykawki.
  - Wprowadzić zespół cewnik wprowadzający/igłę wprowadzającą z dołączoną strzykawką do żyły obok igły zastosowanej do identyfikacji żyły i zaaspirować. Usunąć igły do identyfikacji żyły. Wycofać igły z cewnika wprowadzającego. Jeżeli po wycofaniu igły nie następuje swobodny wypływ krwi z żyły, przyczymocować strzykawkę do cewnika i zaaspirować do czasu pojawienia się dobrego wypływu krwi z żyły. **Przestroga:** Kolor aspirowanej krwi nie zawsze jest niezawodnym wskaźnikiem uzyskania dostępu zylnego.<sup>10</sup> Nie należy powtórnie wprowadzać igły do cewnika wprowadzającego. Z powodu możliwości niezamierzonych umieszczenia w tleńicy, należy potwierdzić uzyskanie dostępu zylnego poprzez wykres uzyskany ze skalibrowanego przekaznika ciśnienia (patrz rys. 2). Jeżeli nie jest dostępny sprzęt do monitorowania hemodynamicznego umożliwiający przetwarzanie wykresu ciśnienia z żyły centralnej, należy odłączyć strzykawkę i sprawdzić, czy występuje przepływ pulsacyjny. Przepływ pulsacyjny jest zwykle wskazaniem, iż doszło do niezamierzonego nakałcia tleńicy.

#### Technika alternatywna:

Mozna zastosować igłę wprowadzającą w typowy sposób zamiast zespołu cewnika/igły.

  - Wprowadzić żadaną końcówkę prowadnika sprężynowego przez cewnik lub igłę wprowadzającą do żyły. Jeżeli używana jest końcówka prowadnika sprężynowego w kształcie litery „J”, należy go przygotować do wprowadzenia nasuwając plastikową rurkę na końcówkę „J” by ją wyprostować. Następnie w rutynowy sposób wprowadzić prowadnik sprężynowy na żadaną głębokość. Przesuwanie do przodu końcówki „J” może wymagać delikatnego ruchu obrotowego. **Ostrzeżenie:** Prowadnika sprężynowego nie wolno ciąć, aby zmienić jego długość. Aby zmniejszyć ryzyko odcięcia lub uszkodzenia prowadnika sprężynowego, nie należy przy wyciąfywaniu prowadnika sprężynowego opierać go o skos igły.
  - Przytrzymaj prowadnik sprężynowy w miejscu i wyjmij igłę wprowadzającą lub cewnik. **Przestroga:** Należy cały czas mocno trzymać prowadnik sprężynowy.
  - Powiększyć miejsce nakałcia skóry z tnącym ostrzem skalpelu zwrotnym w kierunku przeciwnym do prowadnika sprężynowego. **Przestroga:** Nie przecinać prowadnika. Za pomocą rosszerzaca do naczyni poszerzyć miejsce wprowadzenia według potrzeby. **Ostrzeżenie:** Nie pozostawiać rosszerzaca w naczyniu, by zmniejszyć ryzyko możliwej perforacji ściany naczynia.
  - Nasunąć końcówek cewnika na prowadnik sprężynowy. Na końcu cewnika przy złączce musi pozostać odkryty wystarczający odcinek prowadnika, aby można było go pewnie uchwycić. Uchwyciwcy niedaleko skóry, wsuwaj cewnik lekkim ruchem obrotowym w zyle. **Przestroga:** Nie wolno mocować do cewnika zaciśku i elementu do mocowania cewnika (jeśli wchodzi w skład zestawu), zanim nie zostanie usunięty prowadnik sprężynowy.
  - Wprowadzić cewnik do ostatecznego położenia, korzystając z podziałki centymetrowej (jeśli jest) jako punktu odniesienia.
  - Przytrzymać cewnik na odpowiednią głębokość i usunąć prowadnik sprężynowy. Wchodzący w skład tego wyrobu cewnik Arrow został zaprojektowany tak, aby przesuwać się swobodnie po prowadniku sprężynowym. Napotkanie oporu podczas próby wyciągnięcia prowadnika sprężynowego po umieszczeniu cewnika oznacza może, że prowadnik sprężynowy zapęli się wokół końcówki cewnika w naczyniu (patrz rys. 3).

W takiej sytuacji ciagnięcie prowadnika sprężynowego może spowodować działanie na niego nadmiernych sił i pęknięcie go. W razie napotkania oporu należy cofnąć cewnik o 2-3 cm w stosunku do prowadnika sprężynowego i spróbować ponownie wyjąć prowadnik sprężynowy. W przypadku napotkania ponownego oporu należy usunąć równocześnie prowadnik sprężynowy i cewnik. **Ostrzeżenie:** Mimo, że awaria prowadnika sprężynowego zdarza się niezwłocznie rzadko, przeprowadzając zabieg lekarz powinien wiedzieć, że prowadnik może ulec uszkodzeniu, jeśli będzie używany z zastosowaniem nadmiernej siły.

  - Po usunięciu prowadnika sprężynowego należy się upewnić, że został wyjęty w całości i w stanie nienaruszonym.
  - Sprawdzić położenie kanału przyczymocować strzykawkę do cewnika i aspirując do czasu pojawienia się swobodnego wypływu krwi z żyły. Podłączyć odpowiedni przewód z łącznikiem Luer-Lock, według potrzeby, lub zabezpieczyć przez nasadkę iniecyjną, według standardowego protokołu szpitala. Zaciśk suwakowy, jeśli jest dostarczony, służy do zamknięcia przewodu przedłużającego celem wstrzymywania przepływu przez cewnik podczas zmian przewodów i nasadek iniecyjnych. **Przestroga:** Aby zapobiec uszkodzeniu przewodów przedłużających nadmiernym ciśnieniem, przed wlewem przez cewnik należy otworzyć zaciśk.
  - Przymocować cewnik i założyć tymczasowy opatrunek.
  - Natychmiast po umieszczeniu należy wykonać zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej i potwierdzić położenie końcówki cewnika. **Przestroga:** Na zdjściu rentgenowskim cewnik musi znajdować się po prawej stronie śródpiersia w górnej żyły głównej, dystalny koniec cewnika musi być równoległy do

**ściany żyły głównej, a dystalna końcówka umieszczona albo powyżej żyły nieparzystej, albo ostrogi tchawicy, jeżeli łatwiej ją zobrazować.** Jeżeli końcówka cewnika jest umieszczona niewłaściwie, należy zmienić położenie i ponownie je potwierdzić.

17. Przymocować cewnik do pacjenta. Wykorzystać zintegrowany pierścień do szwów i/lub skrzydełka boczne jako główne miejsce założenia szwów. Jeżeli zestaw zawiera zacisk i element do mocowania cewnika, należy je wykorzystać w razie potrzeby jako dodatkowe miejsca założenia szwów. **Przestroga: Nie należy zakładać szwów bezpośrednio na zewnętrze cewnika, aby zapobiec jego nacięciu, uszkodzeniu lub zahamowaniu przepływu przez cewnik.**

**Instrukcję stosowania zacisku i elementu do mocowania cewnika (jeśli jest w zestawie):**

- Po wyjęciu prowadnika sprężynowego i podłączeniu lub zablokowaniu koniecznych przewodów, rozłożyć skrzydełka gumowego zacisku i umieść na cewniku według potrzeby, aby zapewnić właściwe położenie końcówki (patrz rys. 4).
  - Nasunąć element do mocowania na zacisk cewnika (patrz rys. 5).
  - Przymocować cewnik do pacjenta przyszywając razem do skóry zacisk i element do mocowania cewnika, używając skrzydełek bocznych, aby zminimalizować ryzyko migracji cewnika (patrz rys. 6).
18. Opatrź miejsce wkładu zgodnie z zasadami obowiązującymi w danej placówce. **Przestroga: Miejsce wprowadzenia należy bardzo starannie pielęgnować, zmieniając regularnie opatrunk przestrzegając zasad aseptyki.**
19. Zapisać na karcie pacjenta długość cewnika według oznaczeń centymetrowych na cewniku (jeśli są) w miejscu, gdzie cewnik wchodzi pod skórę. Należy często sprawdzać wzrokowo położenie cewnika, aby się upewnić, że cewnik się nie przesunął.
20. Jeżeli w skład zestawu wchodzi rurka filtracyjna, można jej użyć do zasysania leków z otwartych ampulek.

**Procedura wymiany cewnika:**

1. Stosować zasady aseptyki.
2. **Przestroga: Przed przystąpieniem do zabiegu wymiany cewnika należy zdjąć zacisk i element do mocowania cewnika (jeśli był w zestawie).**
3. Postępować zgodnie z protokołem szpitalnym. Nie zaleca się przecinania cewnika ze względu na możliwość zatoru spowodowanego cewnikiem.

**Procedura wyjmowania cewnika:**

1. **Przestroga: Ułożyć pacjenta na plecach.**
2. Zdjąć opatrunk. **Przestroga: Aby zminimalizować ryzyko przecięcia cewnika, do zdejmowania opatrunku nie wolno używać nożyczek.**
3. **Ostrzeżenie: Kontakt żyły centralnej z ciśnieniem atmosferycznym może spowodować wejście powietrza do centralnego układu żylnego.** Zdjąć szwy z zacisku cewnika, jeśli jest, i z głównego miejsca zakładania szwów. Należy uważać, by nie przeciąć cewnika. Powoli wyjąć cewnik wysuwając go równolegle do skóry. Kiedy cewnik wychodzi z miejsca wkłucia, przecisnąć opatrunkiem nieprzepuszczającym powietrza, np. gazą VASELINE. Ponieważ śląd po wprowadzeniu cewnika pozostaje punktem lutowym powietrza do czasu całkowitego uszczelnienia, opatrunk okluzyjny powinien pozostać na miejscu przez co najmniej 24–72 godziny, w zależności od tego, jak długo cewnik był w ciele pacjenta.<sup>11,14,16,19</sup>
4. Po wyjęciu cewnika należy go obejrzeć, aby się upewnić, że została usunięta cała jego dugość.
5. Odnotować zabieg usunięcia cewnika w dokumentacji.

Arrow International, Inc. zaleca, aby użytkownicy zapoznali się z literaturą przedmiotu.

\*Wszelkie pytania lub zamówienia odnośnie literatury przedmiotu należy kierować do Arrow International, Inc.



# Produto para Cateterização Venosa Central com Lúmen Simples

## Considerações Sobre Segurança e Eficácia:

Não utilize caso a embalagem tenha sido previamente aberta ou danificada. **Aviso:** Antes de utilizar, leia todos os avisos, precauções e instruções constantes no folheto acompanhante. Se não o fizer, poderá provocar lesões graves ou mesmo a morte do doente.

Não altere o cateter, o fio guia ou qualquer outro componente do kit/conjunto durante a introdução, utilização ou remoção.

O procedimento deve ser realizado por pessoal treinado, com conhecimentos profundos das referências anatómicas, da técnica mais segura e potenciais complicações.

**Aviso:** Não coloque o cateter nem deixe que este permaneça na aurícula direita ou ventrículo direito (consulte a Fig. 1).

### Tamponamento Cardíaco:

Tem sido documentado por muitos autores que a colocação de catetores permanentes na aurícula direita é uma prática perigosa<sup>1,2,3,5,7,13,15</sup> que pode dar origem a perfuração e tamponamento cardíaco.<sup>1,2,3,5,13,15</sup> Apesar de o tamponamento cardíaco provocado por derrame pericárdico ser pouco frequente, existe uma elevada taxa de mortalidade associada ao mesmo.<sup>17</sup> Os médicos que colocam catetores venosos centrais devem estar conscientes desta complicaçāo potencialmente fatal antes de introduzirem demasiado o cateter em relação às dimensões do doente.

Nenhum percurso específico ou tipo de cateter está isento de provocar esta complicaçāo potencialmente fatal.<sup>15</sup> A posição exacta da ponta do cateter permanente deve ser confirmada por radiografia executada após a introdução.<sup>1,2,5,13,15,18</sup> Os catetores venosos centrais devem ser colocados na veia cava superior<sup>1,2,3,5,7,13,20</sup> por cima da sua junção com a aurícula direita e paralelamente à parede do vaso<sup>9,20</sup> e a sua ponta distal colocada a um nível acima da veia ázigos ou da carina da traqueia, dependendo de qual se observa melhor.

Os catetores venosos centrais não devem ser colocados na aurícula direita, a não ser que tal seja especificamente necessário para procedimentos com duração relativamente pequena, como por exemplo a aspiração de êmbolos gasosos durante intervenções neurocirúrgicas. Contudo, estes procedimentos conduzem a riscos e devem ser monitorizados e controlados com muita atenção.

## Indicações para Utilização:

O cateter de lúmen simples permite o acesso venoso à circulação central.

## Contra-indicações:

Desconhecidas.

## Avisos e Precauções:<sup>\*</sup>

- Aviso:** Estéril, utilização única; não reutilizar, reprocessar ou reesterilizar. A reutilização do dispositivo cria um potencial risco de lesões graves e/ou infecção que poderão resultar em morte.

- Aviso:** Não coloque o cateter nem deixe que este permaneça na aurícula direita ou ventrículo direito. Os cateteres venosos centrais devem ser colocados de maneira a que a sua ponta distal se encontre na veia cava superior (VCS), por cima da sua junção com a aurícula direita e paralelamente à parede do vaso. Para a abordagem pela veia femoral, o cateter deve ser introduzido no vaso de forma a que a ponta do cateter fique paralela à parede do vaso e não entre na aurícula direita.
- Aviso:** Os médicos devem estar familiarizados com as complicações associadas a cateteres venosos centrais, incluindo o tamponamento cardíaco resultante da perfuração ventricular, auricular ou da parede do vaso, lesões pleurais e mediastínicas, embolia gasosa, embolia do cateter, laceração do ducto torácico, bactériemia, septicémia, trombose, punção arterial accidental, lesão nervosa, hematoma, hemorragia e arritmias.
- Aviso:** Não aplique demasiada força durante a remoção do fio guia ou dos catetores. No caso da remoção ser difícil de realizar, deve ser efectuada uma radiografia torácica e solicitada uma consulta adicional.
- Aviso:** O médico deve estar familiarizado com a possibilidade de uma embolia gasosa, que poderá ocorrer se deixar agulhas ou catetores abertos em locais de punção venosa ou em consequência de desconexões acidentais. Para diminuir o risco de desconexões, só deverão ser utilizadas com este dispositivo conexões Luer-Lock bem apertadas. Siga o protocolo hospitalar em tudo o que diz respeito à manutenção de cateteres, a fim de prevenir uma embolia gasosa.
- Aviso:** A introdução do fio guia dentro das cavidades cardíacas direitas poderá provocar disritrias, bloqueio de ramo direito<sup>6</sup> e perfuração da parede de vasos, da aurícula ou do ventrículo.
- Aviso:** Devido ao risco de exposição ao VIH (Vírus da Imunodeficiência Humana) ou a outros agentes patogénicos transmitidos pelo sangue, todos os profissionais de saúde devem utilizar como rotina métodos universais de prevenção sempre que lidam com sangue e fluidos corporais de qualquer doente.
- Precaução:** Os catetores permanentes devem ser inspecionados regularmente para verificação do fluxo pretendido, da fixação do penso, do correcto posicionamento do cateter e da estabilidade da conexão Luer-Lock. Utilize as marcas em centímetros para detectar eventuais mudanças de posição do cateter.
- Precaução:** Um exame radiográfico da colocação do cateter é a única maneira de assegurar que a ponta do cateter não penetrou no coração, ou que já não se encontra paralela à parede do vaso. Se a posição do cateter mudou, efectue imediatamente um exame radiográfico para confirmar a posição da ponta do cateter.
- Precaução:** O álcool e a acetona podem enfraquecer a estrutura dos materiais de poliuretano. Verifique se os ingredientes dos sprays e compressas de desinfecção incluem acetona ou álcool. **Acetona:** Não utilize acetona sobre a superfície do cateter. A acetona pode ser aplicada sobre a pele, devendo secar

- completamente antes de ser aplicado o penso.**
- Alcool:** Não utilize álcool para molhar a superfície do cateter nem para restabelecer a permeabilidade do mesmo. Deverá ser usada precaução quando forem instilados fármacos que contenham elevadas concentrações de álcool. Deixe sempre o álcool secar completamente antes de aplicar o penso.
- 11. Precaução:** Alguns desinfectantes utilizados no local de introdução do cateter contêm solventes, os quais podem atacar o material do cateter. Certifique-se de que o local de introdução está seco antes de aplicar o penso.
- 12. Precaução:** A utilização de uma seringa de capacidade inferior a 10 ml para irrigar ou remover coágulos de um cateter obstruído pode provocar fugas intraluminais ou ruptura do cateter.<sup>6</sup>
- ## A Procedimento Sugerido: Utilize uma técnica estéril.
- Precaução:** Coloque o doente numa posição de Trendelenburg ligeira, conforme tolerado, para diminuir o risco de embolia gássica. Se for utilizada a via de abordagem femoral, coloque o doente na posição de decúbito dorsal.
  - Coloque o campo e desinfecte o local a puncionar conforme for necessário.
  - Anestesie a pele com a agulha pretendida (agulha de 25 Ga. ou 22 Ga.).
  - Prepare o cateter para a introdução irrigando o lumen. Deixe o cateter desadaptado para passagem do fio guia. **Aviso:** Não corte o cateter para alterar o seu comprimento.
  - Localize a veia central com uma agulha 22 Ga. e seringa.
  - Introduza o conjunto agulha/cateter introdutor, com uma seringa adaptada, na veia junto à agulha localizadora, e aspire. Remova a agulha localizadora. Remova a agulha do cateter introdutor. Se não observar fluxo livre de sangue venoso após a remoção da agulha, adapte a seringa ao cateter e aspire até obter um bom fluxo de sangue venoso. **Precaução:** A cor do sangue aspirado não constitui sempre um indicador fiável de acesso venoso.<sup>10</sup> Não volte a introduzir a agulha no cateter introdutor. Devido ao risco de colocação accidental do cateter numa artéria, comprove o acesso venoso através do traçado obtido por um transdutor de pressão calibrado (consulte a Fig. 2).
- Se não existir equipamento de monitorização hemodinâmica disponível para a obtenção do traçado da pressão venosa central por transdução, desadapte a seringa e verifique se existe algum fluxo pulsátil. A presença de um fluxo pulsátil é geralmente indicador de punção arterial accidental.
- Técnica Alternativa:**  
A agulha introdutora pode ser utilizada da forma habitual, como alternativa ao conjunto cateter/agulha.
- Introduza a ponta desejada do fio guia através da agulha ou do cateter introdutor, dentro da veia. Se for utilizada a ponta em "J" do fio guia, prepare a introdução deslizando o tubo de plástico sobre o "J", para o endireitar. O fio guia deverá então avançar da forma habitual até à profundidade pretendida. Para avançar a ponta em "J" poderá ser necessário um ligeiro movimento de rotação. **Aviso:** Não corte o fio guia para alterar o comprimento. Não retire o fio guia contra o bisel da agulha, para minimizar o risco de um possível corte ou de danos no fio guia.
  - Mantenha o fio guia em posição e remova a agulha introdutora ou cateter. **Precaução:** Mantenha sempre o fio guia bem preso.
  - Alargue o orifício no local da punção cutânea, com o bordo cortante da lámina do bisturi virado na direcção oposta ao fio guia. **Precaução:** Não corte o fio guia. Utilize o dilatador de vasos para alargar o local, conforme for necessário. **Aviso:** Para minimizar o risco de uma eventual perfuração da parede do vaso, não deixe o dilatador de vasos no local como um cateter permanente.
  - Enrosque a ponta do cateter sobre o fio guia. Para manter o fio guia bem preso, deve ficar exposto um comprimento suficiente de fio guia na extremidade do conector do cateter. Agarrando na pele circundante, introduza o cateter dentro da veia com um ligeiro movimento de torção. **Precaução:** No caso de o grampo e o fixador do cateter serem fornecidos, não os ligue ao cateter até que o fio guia tenha sido removido.
  - Avance o cateter até à sua posição permanente final utilizando as marcas em centímetros (quando fornecidas) como pontos de referência para o posicionamento.
  - Segure o cateter na profundidade pretendida e remova o fio guia. O cateter Arrow incluído neste produto foi concebido para deslizar livremente sobre o fio guia. Se sentir alguma resistência quando tentar remover o fio guia depois da colocação do cateter, o fio guia poderá estar dobrado na ponta do cateter, ainda dentro do vaso (consulte a Fig. 3). Nesta circunstância, o puxar do fio guia pode provocar a aplicação de uma força excessiva e provocar a fractura do fio guia. Caso encontre resistência, retire o cateter correspondente ao fio guia cerca de 2-3 cm e tente retirar o fio guia. Caso continue a encontrar resistência, retire o fio guia e o cateter simultaneamente. **Aviso:** Embora a incidência de falhas do fio guia seja muito baixa, o médico deverá estar atento à possibilidade de fractura no caso de aplicação de força excessiva sobre o mesmo.
  - Confirme que o fio guia se encontra intacto após a remoção.
  - Verifique a colocação do lumen adaptando uma seringa ao cateter e aspirando até observar um fluxo de sangue venoso livre. Ligue a linha Luer-Lock adequada, conforme for necessário, ou "bloqueie" através da tampa de injecção usando o protocolo hospitalar padrão. Quando fornecido, o grampo deslizante da linha de extensão é utilizado para ocluir o fluxo através do cateter durante a mudança da linha e da tampa de injecção. **Precaução:** Para minimizar o risco de danificar a linha de extensão devido a pressão excessiva, deve abrir-se o grampo antes de iniciar a infusão através do cateter.
  - Fixe e cubra temporariamente o cateter com um penso.
  - Confirme a posição da ponta do cateter através de uma radiografia torácica realizada imediatamente após a sua colocação. **Precaução:** O exame radiográfico deve mostrar o cateter localizado no lado direito do mediastino, na veia cava superior, com a extremidade distal do cateter paralela à parede da veia cava e a ponta distal a um nível acima da veia ázigos ou da carina da traquéia, dependendo de qual se veja melhor. Caso a ponta do cateter não se encontre correctamente posicionada, reposicione-a e volte a confirmar a sua posição.
  - Fixe o cateter ao doente. Utilize o anel de sutura integral e/ou as asas laterais como local principal de sutura. Nos kits em que é fornecido, o grampo e fixador do cateter devem ser utilizados como local secundário de sutura, conforme for necessário. **Precaução:** Não suture directamente ao diâmetro exterior do cateter para minimizar o risco de corte ou dano do cateter, ou de impedir o fluxo do mesmo.
- Instruções de Utilização do Grampo e Fixador do Cateter (quando fornecido):**
- Depois de retirar o fio guia e ligar ou fixar a linha, abra as asas do grampo de borracha e posicione-o no cateter, conforme for necessário, para garantir a permanência da ponta do cateter no local apropriado (consulte a Fig. 4).

- Encaixe o fixador rígido no grampo do cateter (consulte a Fig. 5).
  - Fixe o cateter ao doente suturando o grampo e o fixador do cateter à pele, utilizando as asas laterais para minimizar o risco de migração do cateter (consulte a Fig. 6).
18. Cubra o local da punção com pensos, de acordo com o protocolo hospitalar. **Precaução:** Mantenha o local de introdução com pensos regulares e meticulosos utilizando a técnica de assépsia.
19. Registe na ficha do doente o comprimento do cateter permanente usando as marcações em centímetros (quando fornecidas) do cateter onde entra na pele. Deve ser feita uma reavaliação visual frequente, para garantir que o cateter não se moveu.
20. Nos kits em que é fornecida, poderá utilizar a palhinha com filtro para recolher os medicamentos das ampolas abertas.

## Procedimento de Substituição do Cateter:

1. Utilize uma técnica estéril.
2. **Precaução:** Antes de tentar efectuar um procedimento de substituição do cateter, retire o grampo e fixador do cateter, quando fornecidos.
3. Proceda em conformidade com o protocolo hospitalar. Não se recomenda cortar o cateter devido à possibilidade de embolia do cateter.

## Procedimento para Remoção do Cateter:

1. **Precaução:** Coloque o doente na posição de decúbito dorsal.
2. Retire o penso. **Precaução:** Para minimizar o risco de corte do cateter, não utilize uma tesoura para retirar o penso.
3. **Aviso:** A exposição da veia central à pressão aósférica poderá resultar na entrada de ar para dentro do sistema venoso central. Retire a(s) sutura(s) do grampo do cateter, quando fornecido, e do local de sutura principal. Tenha cuidado para não cortar o cateter. Retire o cateter lentamente, puxando-o paralelamente à pele. À medida que o cateter sai do local, deve aplicar-se pressão com um penso impermeável ao ar, por exemplo gaze impregnada com VASELINE. Uma vez que o trajecto residual do cateter continua a permitir a entrada de ar até estar completamente vedado, o penso oclusivo deverá permanecer no local durante pelo menos 24-72 horas, dependendo do período de permanência do cateter.<sup>11,14,16,19</sup>
4. Após a remoção do cateter, inspecione-o de forma a garantir que saiu na sua totalidade.
5. Registe a remoção do cateter.

A Arrow International, Inc. recomenda que o utilizador esteja a par da literatura de referência.

\*Em caso de dúvidas ou necessidade de informações adicionais específicas, por favor contacte a Arrow International, Inc.

## Однопросветное изделие для катетеризации центральных вен

### Вопросы безопасности и эффективности:

Не используйте, если упаковка была ранее вскрыта или повреждена. **Предостережение:** Перед применением изделия ознакомьтесь с инструкциями, находящимися внутри упаковки, и изучите все меры предосторожности и предупреждения. Несоблюдение данного предупреждения может привести к серьезной травме пациента или его смерти.

Не изменяйте катетер, проводник и другие компоненты комплекта/набора во время введения, применения или извлечения.

Процедура должна выполняться подготовленным персоналом, имеющим большой опыт в области анатомической привязки, в обеспечении безопасности, а также хорошо знакомым с возможными осложнениями.

**Предостережение:** Не устанавливайте катетер в правое предсердие или правый желудочек и не оставляйте его там (см. рис. 1).

### Тампонада сердца:

Многими авторами было отмечено, что размещение постоянных катетеров в правом предсердии является опасной практикой,<sup>1,2,3,5,7,13,15</sup> которая может привести к перфорации и тампонаде сердца.<sup>1,2,3,5,13,15</sup> Несмотря на то, что тампонада сердца в результате перикардиального излияния происходит не часто, с ней связан высокий процент смертности.<sup>17</sup> Медперсонал, занимающийся вводом катетеров в центральные вены, должен быть осведомлен об этом смертельном осложнении, прежде чем вводить катетер слишком далеко без учета размеров пациента.

Нет конкретного пути ввода или типа катетера, позволяющих исключить это потенциально смертельное осложнение.<sup>15</sup> После введения катетера фактическое положение его кончика должно быть проверено рентгеновским обследованием.<sup>1,2,5,13,15,18</sup> Центральные венозные катетеры должны размещаться в верхней полой вене<sup>1,2,3,5,7,13,20</sup> над ее соединением с правым предсердием и параллельно стенке сосуда;<sup>9,20</sup> при этом дистальный конец катетера должен располагаться либо над уровнем непарной вены, либо над килем трахеи – в зависимости от того, что лучше наблюдается.

Центральные венозные катетеры не должны размещаться в правом предсердии, если этого не требуют относительно краткосрочные процедуры, например, аспирация воздушных эмболов в ходе нейрохирургической операции. Тем не менее, такие процедуры рискованны и должны строго контролироваться и тщательно наблюдаваться.

### Показания к применению:

Однопросветный катетер позволяет получить доступ через вены к системе центрального кровообращения.

### Противопоказания:

Не известны.

### Предупреждения и меры предосторожности:\*

1. **Предостережение:** Стерильно, одноразового применения: Не использовать повторно, не обрабатывать вторично и не стерилизовать. Повторное использование устройства создает риск серьезной травмы и/или инфекции, которые могут привести к смертельному исходу.
2. **Предостережение:** Не устанавливайте катетер в правое предсердие или правый желудочек и не оставляйте его там. Центральные венозные катетеры должны размещаться так, чтобы дистальный конец катетера находился в верхней полой вене – над соединением верхней полой вены и правого предсердия – и располагался параллельно стенке сосуда. При доступе через бедренную вену катетер необходимо вводить в сосуд так, чтобы его конец был параллелен стенке сосуда и не входил в правое предсердие.
3. **Предостережение:** Медперсонал должен знать об осложнениях, связанных с применением центральных венозных катетеров, включая тампонаду сердца в результате перфорации стенки сосуда, пресервия или желудочка, плевральные и медиастинальные повреждения, воздушную эмболию, эмболию катетера, разрыв грудного протока, бактериемию, сепсис, тромбоз, непреднамеренный прокол артерии, повреждение нерва, гематому, геморрагию и дисритмию.
4. **Предостережение:** Не применяйте чрезмерных усилий при извлечении проводника или катетеров. Если возникли проблемы с извлечением, необходимо сделать рентгенографию грудной клетки и дополнительно проконсультироваться.
5. **Предостережение:** Медперсонал должен осознавать возможность воздушной эмболии, связанной с оставлением в месте прокола центральных вен сообщающихся с окружающей средой игл или катетеров, либо вследствие случайного нарушения соединений. С целью уменьшения риска разъединения с данным устройством должны использоваться только надежно затянутые соединения, спаенные наконечниками Лиора. В целях предотвращения воздушной эмболии соблюдайте протокол лечебного учреждения при любых действиях по обслуживанию катетера.
6. **Предостережение:** Прохождение проводника в правые отделы сердца может стать причиной дисритмии, блокады правой ветви пучка Гиса<sup>8</sup> и перфорации блоков сосуда, предсердия или желудочка.
7. **Предостережение:** Из-за риска заражения ВИЧ (вирусом иммунодефицита человека) или другими передаваемыми с кровью патогенными микроорганизмами при уходе за всеми пациентами работники здравоохранения должны постоянно соблюдать всесторонние меры предосторожности при контакте с кровью и физиологическими жидкостями.

- 8. Предостережение:** В случае постоянно введенных катетеров необходимо регулярно проверять скорость потока, плотность повязки, правильность местоположения катетера и надежность соединений с наконечниками Люзера. Изменение положения катетера определяйте по сантиметровым меткам.
- 9. Предостережение:** Только рентгенография местоположения катетера даст возможность убедиться, что его кончик не вошел в сердце и по-прежнему располагается параллельно стенке сосуда. Если положение катетера изменилось, немедленно сделайте рентгенографию грудной клетки, чтобы проверить положение кончика катетера.
- 10. Предостережение:** Спирт и ацетон могут ослабить структуру полимерных материалов. Проверьте состав аэрозолей и тампонов для подготовки пациента на предмет наличия ацетона или спирта.
- Ацетон: Не допускайте попадания ацетона на поверхность катетера. Допускается нанесение ацетона на кожу, однако до наложения повязки он должен полностью испариться.
- Спирт: Не используйте спирт для вымыкания поверхности катетера или восстановления его проходимости. При введении препаратов с высоким содержанием спирта необходимо соблюдать меры предосторожности. Перед наложением повязки всегда давайте спирту полностью испариться.
- 11. Предостережение:** Некоторые средства дезинфекции, используемые в месте введения катетера, содержат растворители, способные разрушать материал катетера. Перед наложением повязки убедитесь в том, что место введения катетера сухое.
- 12. Предостережение:** Использование шприцев объемом менее 10 мл для промывки закупорившегося катетера или удаления из него стуктов может привести к утечке внутрь просвета или разрыву катетера.<sup>6</sup>

## Предлагаемая процедура:

### Используйте стерильные приемы.

- 1. Предостережение:** Для снижения риска воздушной эмболии поместите пациента в облегченный вариант позы Тренделенбурга (насколько она будет для него приемлема). При установке катетера на бедре уложите пациента на спину.
2. Надлежащим образом подготовьте и задрапируйте место прокола.
3. Инфильтрируйте кожу в намеченном месте иглой необходимого размера (25 или 22 G).
4. Подготовьте катетер к введению, промыв его прополисом. Не надевайте на катетер колпачок, чтобы можно было ввести в него проводник. **Предостережение: Не обрезайте катетер для изменения его длины.**
5. Найдите центральную вену при помощи иглы 22 G и шприца.
6. Введите катетер на игле или пункционную иглу с присоединенным шприцем в вену рядом с иглой-искателем и аспирируйте. Извлеките иглу-искатель. Извлеките иглу из катетера. В случае отсутствия свободного венозного кровотока после извлечения иглы подсоедините к катетеру шприц и аспирируйте до установления нормального венозного кровотока. **Предостережение: Цвет аспирированной крови не всегда является надежным показателем доступа в вену.<sup>10</sup> Не вводите повторно иглу в катетер.** Чтобы избежать случайной установки катетера в артерии, убедитесь в наличии венозного доступа, ориентируясь по форме импульсов, поступающих с откалиброванного датчика давления (см. рис. 2).
- В отсутствие оборудования гемодинамического мониторинга, позволяющего преобразовать импульсы центральных вен, отсоедините шприц и проверьте пульсирующий кровоток. Пульсирующий кровоток, как правило, свидетельствует о случайном проколе артерии.
- Альтернативный метод:**
- В качестве альтернативы катетеру на игле можно стандартным методом использовать пункционную иглу.
- 7. Ведите в вену необходимый кончик проводника через пункционную иглу или катетер.** Если используется J-образная часть проводника, то необходимо подготовить его к введению, пропустив J-образную часть через пластиковую трубку для ее выпрямления. Затем проводник должен быть продвинут обычным способом на необходимую глубину. Для продвижения J-образного конца могут потребоваться легкие вращательные движения. **Предостережение: Не режьте проводник, чтобы уменьшить его длину. Не извлекайте проводник по среду иглы, чтобы уменьшить риск разрыва или повреждения проводника.**
- 8. Удерживая его на месте, удалите пункционную иглу или катетер. Предостережение: Постоянно прочно удерживайте проводник.**
- 9. Расположив скальпель в стороне от проводника, расширьте место введения катетера. Предостережение: Не обрежьте проводник!** При необходимости расширения места ввода используйте расширители сосудов. **Предостережение: Для сведения к минимуму риска возможной перфорации сосуда, не оставляйте на месте расширителя сосуда в качестве постоянного катетера.**
- 10. Наденьте кончик катетера на проводник.** Для обеспечения прочного удержания проводника он должен оставаться свободным на достаточную длину со стороны втулки катетера. Удерживая катетер рядом с кожей, легкими вращательными движениями введите его в вену. **Предостережение: В случае наличия зажима и фиксатора они не должны подсоединяться к катетеру до извлечения проводника.**
- 11. Пользуясь сантиметровыми метками на катетере (где это предусмотрено) в качестве контрольных точек, продвигните катетер к окончательному месту размещения.**
- 12. Удерживая катетер на требуемой глубине, удалите проводник.** Катетер Atgov, входящий в настоящее изделие, сконструирован таким образом, чтобы свободно проходить по проводнику. Если при извлечении проводника после размещения катетера возникают затруднения, то это может свидетельствовать об образовании петли проводника вокруг кончика катетера, расположенного внутри сосуда (см. рис. 3).
- В этом случае вытягивание проводника назад может потребовать чрезмерного усилия, приводящего к его разрыву. При возникновении сопротивления вытащите катетер на 2-3 см относительно проводника и попытайтесь удалить проводник. Если сопротивление сохраняется, удалите проводник и катетер одновременно. **Предостережение: Несмотря на то, что вероятность выхода из строя проводника крайне мала, медперсонал должен знать о возможности разрыва в случае применения чрезмерного усилия к проводнику.**

13. При извлечении проверьте целостность проводника по всей длине.
  14. Проверьте расположение просветов, подсоединив шприц к каждой уединительной линии и аспирируя до появления свободного венозного кровотока. Подключите соответствующую линию с наконечником Люэра, как это необходимо, или «заприте» катетер через инъекционный колпачок согласно стандартному протоколу лечебного учреждения. Скользящий зажим (где это предусмотрено) устанавливают на уединительную линию, чтобы перекрыть поток через катетер во время смены линии или инъекционного колпачка. **Предостережение: Для сведения к минимуму риска повреждения уединительной линии избыточным давлением перед вливанием жидкости через катетер зажим должен быть открыт.**
  15. Закрепите катетер и наложите временную повязку.
  16. Сразу после размещения проверьте положение кончика катетера при помощи рентгеноскопии грудной клетки. **Предостережение: Рентгеноскопия должна показать, что катетер расположен в правой части средостения в верхней полой вене, причем дистальный конец катетера должен располагаться параллельно стенке полой вены, а его дистальный кончик - либо над уровнем нижней вены, либо над килем трахеи, в зависимости от того, что лучше поддается визуальному контролю.** Если кончик катетера расположен неправильно, измените его положение и сделайте повторную проверку.
  17. Прикрепите катетер к пациенту. Используйте несъемное швоечное кольцо (или) боковые крыльшки в качестве места наложения первичного шва. В тех комплектах, где это предусмотрено, зажим катетера и фиксатор в случае необходимости должны использоваться в качестве места наложения вторичного шва. **Предостережение: В целях снижения риска разрыва или повреждения катетера либо снижения его проходимости не накладывайте шов непосредственно на внешний диаметр корпуса катетера.**
- Инструкция по применению зажима катетера и фиксатора (где это предусмотрено):**
- После того как проводник будет извлечен, а линия подсоединенна или закрыта, расправьте крыльшки резинового зажима и поместите на катетер, что необходимо для обеспечения фиксации кончика в соответствующем положении (см. рис. 4).
  - Пристегните жесткий фиксатор к зажиму катетера (см. рис. 5).
  - Прикрепите катетер к пациенту, наложив скобки или пришив зажим и фиксатор к коже; для сведения к минимуму риска смещения катетера используйте боковые крыльшки (см. рис. 6).
18. Наложите повязку на место прокола в соответствии с протоколом лечебного учреждения. **Предостережение: Регулярно меняйте повязку на месте ввода, тщательно применяя асептические приемы.**
  19. Запишите в карту пациента длину постоянного катетера в соответствии с сантиметровыми метками (где это предусмотрено) на катетере в месте его входа в кожу. Для гарантии неизменности положения катетера необходимо постоянно проводить визуальный осмотр.
  20. В тех комплектах, где это предусмотрено, для извлечения лекарств из открытых ампул можно использовать фильтрующую иглу.

#### **ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СМЕНЫ КАТЕТЕРА:**

1. Используйте стерильные приемы.
  2. **Предостережение: Перед процедурой смены катетера удалите его зажим и фиксатор (где это предусмотрено).**
  3. Продолжите в соответствии с протоколом лечебного учреждения. Не рекомендуется разрезать катетер во избежание его эмболии.
- ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ УДАЛЕНИЯ КАТЕТЕРА:**
1. **Предостережение: Уложите пациента на спину.**
  2. Снимите повязку. **Предостережение: Для сведения к минимуму риска разрезания катетера не используйте ножницы для снятия повязки.**
  3. **Предостережение: Воздействие атмосферного давления на центральную вену может привести к попаданию воздуха в центральную венозную систему. Снимите швы с зажимом катетера, где это предусмотрено, и места первого шва. Избегайте повреждения катетера!** Медленно извлеките катетер, вытаскивая его параллельно поверхности кожи. После извлечения катетера из места введения наложите воздухонепроницаемую повязку, например, из марли VASELINE. Поскольку оставшийся после катетера канал сохраняет (до его полного затяживания) возможность проникновения воздуха, то окклюзионная повязка должна оставаться на месте, по меньшей мере, в течение 24-72 часов в зависимости от времени пребывания катетера в теле пациента.<sup>11,14,16,19</sup>
  4. Сразу после удаления осмотрите катетер, чтобы убедиться в его полном извлечении.
  5. Документально оформите процедуру удаления.

Компания Arrow International, Inc. рекомендует медперсоналу ознакомиться со справочной литературой.

\*Если у Вас возникли какие-либо вопросы или Вам нужна дополнительная информация, свяжитесь с компанией Arrow International, Inc.



## Pripomoček z eno svetlino za centralno vensko katetrizacijo

### Pomisleki glede varnosti in učinkovitosti:

Ne uporabite, če je bila ovojnina predhodno odprta ali poškodovana. **Opozorilo:** Pred uporabo preberite vsa opozorila, previdnostne ukrepe in navodila, priložena v embalaži. Če tega ne storite, lahko pride do resnih poškodb ali smrti bolnika.

Katetra, prožnega žičnatega vodila ali katetrega koli drugega dela kompleta/sklopa med postavljivijo, uporabo ali odstranjevanjem ne spremajte.

Postopek mora izvajati usposobljeno osebje, dobro seznanjeno z anatomskimi oznakami, varnimi tehnikami in možnimi zapleti.

**Opozorilo:** Katetra ne vstavljalte oz. puščajte v desnem predvroru ali desnem srčnem prekatu (glejte sliko 1).

#### Srčna tamponada:

Številni avtorji so dokumentirali, da je namestitve vsajenih katetrov v desni predvror nevarna praksa.<sup>1,2,3,5,7,13,15</sup> ki lahko vodi do perforacije srača in tamponade.<sup>1,2,3,5,13,15</sup> Čeprav srčna tamponada oz. efuzija nista pogosti, je z njima povezana visoka stopnja smrtnosti.<sup>17</sup> Zdravnik, ki namešča centralni venski kateter, mora znati, da potencialno smrtni zaplet, preden kateter vstavi pregloboko glede na bolniškov velikost.

Iz tega potencialno smrtnega zapleta ni izvzeta nobena določena vrsta vstavljanja ali katete.<sup>15</sup> Dejanski položaj konice vsajenega katetra je treba po vstavitvi preveriti z RTG-slikanjem.<sup>1,2,5,13,15,18</sup> Centralne venske katetre je treba vstaviti v zgornjo veno kavovi<sup>1,2,3,5,7,13,20</sup> nad njenim stikom z desnim predvodom in vzporedno z žilno steno,<sup>9,20</sup> distalna konica katetra pa mora biti nad veno azigos ali karino trahije, kateri koli je pač bolje prikazana.

Centralni venski katetri ne smete namestiti v desni predvror, razen če je to posebej potrebno za posebne, dokaj kratkotrajne postopke, kot so izsesavanje zračne embolije med nevrokirurgijo. Tovrstni postopki so kljub temu tvegani in jih je treba pozorno nadzirati in kontrolirati.

### Indikacije za uporabo:

Kateter z eno svetlico omogoča venski dostop do glavnega krvnega obtoka.

### Kontraindikacije:

Niso znane.

### Opozorila in previdnostni ukrepi:<sup>\*</sup>

1. **Opozorilo:** Sterilno, za enkratno uporabo: Ne ponovno uporabiti, obdelati ali sterilizirati. Ponovna uporaba pripomočka ustvari možno tveganje za resne poškodbe in/ali okužbe, kar lahko pride do smrti.
2. **Opozorilo:** Katetra ne smete v desni predvror ali desni prekat niti namestiti, niti ne sme tam ostati. Katetre za centralne vene je treba namestiti tako, da je distalna konica katetra v zgornji veni kavi (ZVK) nad spojem ZVK in desnim prekatom in da leži vzporedno s steno žile. Pri pristopu skozi stegensko veno kateter vstavite v žilo tako, da bo konica katetra vzporedno z žilno steno in da ne bo vstopila v desni predvror.
3. **Opozorilo:** Zdravniki morajo znati možne zaplete, povezane z uvajanjem centralnih venskih katetrov, ki so lahko srčna tamponada po perforaciji žilne stene, preddvora ali srčnega prekata, plevralne in mediastinalne poškodbe, zračna embolija, embolija katetra, raztrganje torakalnega duktusa, bakteriemija, septičemija, tromboza, nemerarna punkcija arterije, poškoda žive, hematom, krvavitve in disritmije.
4. **Opozorilo:** Pri odstranjevanju žičnatega vodila ali katetra ne uporabljajte prevelike sile. Če katetra ne morete izvleči z lahkoto, naredite rentgenski posnetek prsi in se dodatno posvetujte.
5. **Opozorilo:** Zdravnik mora znati možnost zračne embolije, povezane z odprtimi iglami ali katetri na mestih centralne venepunkcije, ali zaradi nemerenih ločitve povezanih ven. Za zmanjšanje tveganja odklopov je treba s tem pripomočkom uporabljati samo varno pričvrščene priključke luer-lock. Pri vzdrževanju katetra upoštevajte bolnišnični protokol za zaščito pred zračno embolijo.
6. **Opozorilo:** Prehod žičnatega vodila v desni srčni prekat lahko povzroči disritmije, blokado desne veje srčnega prevdognega sistema<sup>a</sup> in perforacijo žilne stene, preddvora ali srčnega prekata.
7. **Opozorilo:** Zaradi tveganja izpostavljenosti virusu HIV (virus človeške imunske pomajalkivosti) ali drugim povzročiteljem, ki se prenašajo s krvjo, morajo zdravstveni delavci v skrbni za bolnika rutinsko uporabljati univerzalne varnostne ukrepe pri delu s krvjo ali telesnimi tekočinami.
8. **Previdnostno obvestilo:** Redno pregledujte, ali vsajeni katetri zagotavljajo želeno hitrost pretoka, ali je obvezno varno nameščena, in ali je kateter pravilno in priključek luer-lock varno nameščena. Na oznakah za centimetre lahko opazite, ali se je položaj katetra premaknil.
9. **Previdnostno obvestilo:** Samo z rentgenskim posnetkom namestitve katetra se lahko prepričate, da konica katetra ni vstopila v sreč ali da več ni vzporedna z žilno steno. Če se je položaj katetra spremenil, takoj rentgensko slikajte prsni koš in poglejte, kje je konica katetra.
10. **Previdnostno obvestilo:** Alkohol in aceton lahko ošibita strukuro poliuretanskih materialov. Preverite, ali vsebujejo sestavine pripravljalnih razpršil in paličic aceton in alkohol. **Aceton:** Na površini katetra ne uporabljajte acetona. Aceton lahko naneseš na kožo, vendar se mora pred namestitvijo obvezno popolnoma posušiti. **Alkohol:** Površine katetra ne preprijte z alkoholom in z njim ne poskušajte obnoviti prehodnosti katetra. Bodite previdni pri vkapanju zdravil, ki vsebujejo veliko koncentracijo alkohola. Pred namestitvijo obvezno vedno počakajte, da se alkohol popolnoma posuši.
11. **Previdnostno obvestilo:** Nekatera razkužila, ki se uporabljajo na mestu vstavitve katetra, vsebujejo raztopila, ki lahko razjedajo material katetra. Pred obvezovanjem se prepričajte, da je mesto vstavitve suho.
12. **Previdnostno obvestilo:** Uporaba injekcijske brizge, manjše od 10 ml za izpiranje ali odmahtevanje zamašenega katetra, lahko povzroči puščanje znotraj svetline ali razpok katetra.<sup>6</sup>

## Predlagani postopek:

### Uporabljajte sterilno tehniko.

1. **Previdnostno obvestilo:** Bolnika postavite v rahel Trendelenburgov položaj, kolikor je pač mogoče, da zmanjšate nevarnost zračne embolije. Pri stegenskem pristopu bolnika obrnite na hrbet.
2. Mesto vboda pripravite in ga po potrebi prekrijte.
3. Z želeno iglo preluknjajte kožo (velikost 25 G ali 22 G).
4. Pripravite kateter za vstavitev tako, da izperete svetlinino. Katetra ne zapirajte s pokrovčkom, da pustite prehod za žičnato vodilo. **Opozorilo:** Katetra ne režite, da bi prilagodili dolžino.
5. Centralno veno poiščite z iglo in injekcijsko brizgo velikosti 22 G.
6. Vstavite uvajalni kateter/iglo s pritrjenim brizgo v veno poleg igle za iskanje žil in izsesajte. Odstranite iglo pripomočka za iskanje žil. Izvlecite iglo iz uvajalnega katetra. Če po odstranitvi igle ne zagledate prostega pretoka venske krvi, pritrditte injekcijsko brizgo na kateter in izsesavajte, dokler ne vzpostavite dobrega pretoka venske krvi. **Previdnostno obvestilo:** Barva izsesane krvi ni vedno zanesljiv znak venskega dostopa.<sup>19</sup> Igle ne vstavljajte ponovno in uvajalni kateter. Zaradi možnosti nehotne namestitve v arterijo se o venskem dostopu prepričajte z valovno obliko, pridobljeno s umerjeno tlano sondjo (glejte sliko 2).
- Če ni na voljo hemodinamična nadzorna oprema, ki bi oddajala centralno vensko valovno obliko, odklopite brizgo in preverite pulznji tok. Pulzni tok je običajno znak nehotnega preboda arterije.
- Alternativna tehnika:**  
Uvajalno iglo lahko uporabite na običajni način namesto sklopa katetra in igle.
- Želeno konico prožnega žičnatega vodila potisnite skozi uvajalno iglo ali kateter v veno. Če uporabljate del prožnega žičnatega vodila s konico v obliki črke „J“, se pripravite na vstavljanje tako, da preko konice „J“ potisnete plastično cevko, da konico poravnate. Prožno žičnato vodilo nato na običajni način potisnite do želenih globin. Pri vstavljanju konice „J“ boste morali konico morda nekoliko obračati. **Opozorilo:** Ne režite prožnega žičnatega vodila, da bi spremnili dolžino. Za zmanjšanje tveganja možne ločitve ali poškodbe prožnega žičnatega vodila, ne vlecite prožnega žičnatega vodila ob prirezanem koncu igle.
- Držite prožno žičnato vodilo na mestu in odstranite uvajalno iglo ali kateter. **Previdnostno obvestilo:** Vedno čvrsto držite prožno žičnato vodilo.
- Če želite, lahko povečate kožno mesto vboda z rezilno stranko kirurškega noža, nameščeno stran od prožnega žičnatega vodila. **Previdnostno obvestilo:** Ne režite žičnega vodila. Po potrebi uporabite žilni dilatator, da povečate mesto. **Opozorilo:** Za zmanjšanje tveganja možne perforacije žilne stene ne pustite dilatatorja žile na mestu kot vsajeni kateter.
- Konico katetra napeljite preko prožnega žičnatega vodila. Na strani katetra, kjer je spoj, mora dolžina žičnatega vodila zadoščati, da lahko zanj čvrsto držite. Primitte bližnjo kožo in kateter med vstavljanjem v žilo rahlo obrazčite. **Previdnostno obvestilo:** Objemke na zapestje, če so na voljo, ne pritrjdite na kateter, dokler ne odstranite prožnega žičnatega vodila.
- Kateter potisnite do končnega položaja za vstavitev in si pri tem pomagajte s centimetrskimi oznakami (kjer so) kot referenčnimi točkami za namestitev.
- Kateter pridržite na želenih globinah in odstranite prožno žično vodilo. Kateter Arrow, priložen temu pripomočku, je zasnovan

tako, da nemoteno prehaja preko prožnega žičnega vodila. Če pri odstranjevanju prožnega žičnatega vodila po namestitvi katetra naletite na upor, se je žičnato vodilo pri konici katetra znotraj žile morda zvilo (glejte sliko 3).

V takem primeru se lahko ob vlečenju žica prožnega žičnatega vodila zaradi neustrezne sile pretrega. Če naletite na upor, izvlecite kateter za pribl. 2-3 cm glede na prožno žičnato vodilo in poskusite slednjega odstraniti. Če ponovno naletite na upor, odstranite prožno žično vodilo in kateter hkrati. **Opozorilo:** Čeprav so pojavi nepravilnega delovanja prožnega žičnatega vodila izredno redki, mora zdravnik poznavati možnost, da se lahko žica ob uporabi neustrezne sile pretrega.

13. Po odstranitvi se prepričajte, da ste odstranili celotno prožno žičnato vodilo.

14. Preverite namestitve svetline tako, da pritrdrjte brizgo na kateter in izsesavate, da začne venska kri prosti teči. Povežite ustrezeno linijo luer-lock, kot je potrebno, ali „zaklenite“ skozi injekcijski pokrovček po standardnem bolnišničnem protokolu. Če so na voljo, uporabite drsne stišiške na podaljševalni liniji, da zaprejo pretok skozi kateter med menjavo linije in pokrovčka injekcije. **Previdnostno obvestilo:** Pred infundiranjem skozi kateter odprite stišček, da zmanjšate tveganje poškodovanja podaljševalnega voda zaradi previlegike pritiska.

15. Kateter začasno zaščitite in obvezite.
16. Takoj po namestitvi preverite položaj konice katetra z rentgenom. **Previdnostno obvestilo:** Na rentgenskem posnetku mora biti kateter nameščen na desni strani mediastinuma v ZVK z distalnim koncem katetra vzporedno s steno vene kave in distalno konico nad veno azigos ali trahealno karino, odvisno o tega, katere je bolje prikazana. Če je konica slabо nameščena, jo prestavite in ponovno preverite njen položaj.

17. Pritrditte kateter na bolnika. Za mesto primarnega ſiva uporabite integralni obroček za šivanje in/ali stranska krilca. Če imate v kompleti pribora, morate objemko in sponko katetra po potrebi uporabiti kot mesto sekundarnega ſiva. **Previdnostno obvestilo:** Ne svijte neposredno na zunanjem premeru katetra, da zmanjšate tveganje prerezke ali poškodbe cevke oz. oviranja pretoka skozi kateter.

**Navodila za uporabo objemke in sponke katetra (kjer so priložene):**

- Ko odstranite prožno žičnato vodilo in linije povežete ali zaklenete, razprite krilca gumijaste objemke in jo namestite na kateter za zagotavljanje pravilnega položaja konice (glejte sliko 4).
  - S togo objemko sponite sponko katetra (glejte sliko 5).
  - Objemko in sponko katetra zaščite na bolnika, stranska krilca pa uporabite za zmanjšanje tveganja premikanja katetra (glejte sliko 6).
  - 18. Mesto vboda obvezite v skladu z bolnišničnim protokolom. **Previdnostno obvestilo:** Mesto vstavitev redno negujte z menjavanjem obvez za aseptično tehniko.
  - 19. V bolnikovo kartoteko zapišite dolžino vsajenega katetra, kot prikazujejo centimetrske oznake (če obstajajo) na mestu vstopa v kožo. S pogostimi vizualnimi ocenitvami se prepričajte, da se kateter ni premaknil.
  - 20. V kompleti, kjer je priložen, lahko filtrirno slamicu uporabite za izvlek zdravila iz odprtih ampul.
- Postopek zamenjave katetra:**
1. Uporabljajte sterilno tehniko.
  2. **Previdnostno obvestilo:** Preden poskusite kateter zamenjati, odstranite objemko in sponko katetra (če sta priloženi).

- Ravnajte v skladu z bolnišničnim protokolom. Katetra ni priporočljivo rezati zaradi možnosti embolije katetra.

### **Postopek odstranjevanja katetra:**

- Previdnostno obvestilo: Bolnika obrnite na hrbet.**
- Odstranite obvezo. **Previdnostno obvestilo: Za odstranjevanje obvezе ne uporabljajte škarij, da zmanjšate tveganja prezemanja katetra.**
- Opozorilo: Izpostavitev glavne vene atmosferskemu tlaku lahko vodi do vstopa zraka v srednji žilni sistem.** Odstranite šiv(e) z objemke katetra, če obstaja, in mesta primarnega šiva. Pazite, da ne prerezete katetra. Počasi odstranite kateter tako, da ga vlecete vzporedno s kožo. Ko kateter izstopi, pritisnite

na mesto izstopa z obvezo, neprepustno za zrak, npr. gazo VASELINE. Ker predstavlja preostala pot katetra še naprej vstopno točko za zrak, dokler se popolnoma ne zatesni, mora biti obveza nameščena najmanj 24-72 ur, odvisno od tega, kako dolgo je bil kateter vstavljen.<sup>11,14,16,19</sup>

- Kateter po odstranitvi preglejte in se prepričajte, da je bila odstranjena celotna dolžina.
- Postopek odstranitve dokumentirajte.

Družba Arrow International, Inc. priporoča, da se uporabnik seznanii z referenčno literaturo.

\*Če imate vprašanja ali želite dodatne informacije o referencah, se obrnite na družbo Arrow International, Inc.

## Dispositivo de una sola luz para cateterismo venoso central

### Consideraciones relativas a la seguridad y la eficacia:

No utilizar si el paquete ha sido previamente abierto o está dañado. **Advertencia:** Antes de usar el dispositivo, leer todas las advertencias, precauciones e instrucciones incluidas en el paquete. El no hacerlo puede ocasionar lesiones graves o el fallecimiento del paciente.

No alterar el catéter, la guía de alambre flexible ni ningún otro componente del juego o conjunto durante la inserción, el uso o la extracción.

El procedimiento debe ser realizado por personal especializado con buen conocimiento de los puntos de referencia anatómicos, las técnicas de seguridad y las posibles complicaciones.

**Advertencia:** No colocar ni dejar que el catéter permanezca en la aurícula o ventrículo derechos (véase la Figura 1).

#### Taponamiento cardíaco:

Numerosos autores han documentado que la colocación de catéteres permanentes en la aurícula derecha es una práctica peligrosa<sup>1,2,3,5,7,13,15</sup> que puede provocar perforación y taponamiento cardíacos.<sup>1,2,3,5,13,15</sup> Aunque el taponamiento cardíaco causado por efusión pericárdica es poco frecuente, existe un elevado índice de mortalidad asociado a él.<sup>17</sup> Los médicos que colocan catéteres venosos centrales deben conocer esta complicación potencialmente mortal antes de hacer avanzar demasiado el catéter en relación con el tamaño del paciente.

No existen recorridos ni tipos de catéteres específicos que permitan eliminar esta complicación potencialmente mortal.<sup>15</sup> Despues de la inserción, la posición real de la punta del catéter permanente deberá confirmarse mediante una radiografía.<sup>1,2,5,13,15,18</sup> Los catéteres venosos centrales deben colocarse en la vena cava superior<sup>1,2,3,5,7,13,20</sup> por encima de la unión de la misma con la aurícula derecha y paralelos a la pared del vaso,<sup>9,20</sup> y su punta distal debe situarse a un nivel por encima de la vena ácigos o de la carina traqueal, según cuál de las dos se visualice mejor.

Los catéteres venosos centrales no deben colocarse en la aurícula derecha a menos que sea específicamente necesario para la realización de procedimientos especiales de duración relativamente breve como, por ejemplo, la aspiración de émbolos gaseosos durante una intervención neuroquirúrgica. No obstante, dichos procedimientos conllevan riesgos y deberán ser estrechamente supervisados y controlados.

### Indicaciones de uso:

El catéter de una sola luz permite el acceso venoso a la circulación central.

### Contraindicaciones:

No se conoce ninguna.

#### Advertencias y precauciones:<sup>\*</sup>

1. **Advertencia:** Estéril, para un solo uso; no reutilizar, reprocesar ni reesterilizar. La reutilización del dispositivo genera un riesgo potencial de lesiones graves e infección potencialmente mortal.
2. **Advertencia:** No colocar ni dejar que el catéter permanezca en la aurícula o ventrículo derechos. Los catéteres venosos centrales deben colocarse de manera que su punta distal se encuentre en la vena cava superior, por encima de la unión de ésta con la aurícula derecha, y paralela a la pared del vaso. Para el acceso a través de la vena femoral, el catéter debe hacerse avanzar en el vaso de manera que la punta del catéter permanezca paralela a la pared del vaso y no penetre en la aurícula derecha.
3. **Advertencia:** Los médicos deben estar familiarizados con las complicaciones relacionadas con los catéteres venosos centrales, que incluyen el taponamiento cardíaco causado por la perforación auricular, ventricular o de la pared del vaso, lesiones pleurales y mediastínicas, embolia gaseosa, embolia a causa del catéter, laceración del conducto torácico, bacteriemia, septicemia, trombosis, punción inadvertida de la arteria, daños en nervios, hematoma, hemorragia y disritmias.
4. **Advertencia:** No aplicar una fuerza excesiva al extraer la guía o los catéteres. Si la extracción no puede lograrse con facilidad, debe efectuarse una radiografía del tórax y concertarse una consulta ulterior.
5. **Advertencia:** El médico debe conocer la posibilidad de embolia gaseosa a consecuencia de agujas o catéteres que puedan dejarse abiertos en los sitios en los que se hayan practicado punciones venosas, o debido a desconexiones inadvertidas. A fin de reducir el riesgo de desconexiones, con este dispositivo sólo deben utilizarse conexiones tipo Luer-Lock firmemente apretadas. Para prevenir embolias gaseosas, en todo lo relacionado con el mantenimiento de los catéteres debe seguirse el protocolo del hospital.
6. **Advertencia:** La introducción de la guía de alambre en la parte derecha del corazón puede provocar disritmias, bloqueo de rama derecha<sup>9</sup> y perforación auricular, ventricular o de la pared de los vasos.
7. **Advertencia:** Debido al riesgo de exposición al VIH (virus de inmunodeficiencia humana) o a otros agentes patógenos transmitidos por la sangre, durante el cuidado de los pacientes el personal médico debe observar siempre las normas universales de precaución relacionadas con la sangre y los fluidos corporales.
8. **Precaución:** Los catéteres permanentes deben inspeccionarse regularmente para verificar la velocidad de flujo deseada, la firmeza del vendaje, la posición correcta del catéter y la firme sujeción de las conexiones tipo Luer-Lock. Utilizar las marcas de centímetros para comprobar si ha habido cambios en la posición del catéter.
9. **Precaución:** Un examen radiográfico de la colocación del catéter es la única forma de asegurarse de que la punta no ha penetrado en el corazón o de que ya no está paralela a

- la pared del vaso. Si la posición del catéter ha cambiado, realizar inmediatamente un examen radiográfico del tórax para confirmar la posición de la punta del catéter.**
- 10. Precaución:** El alcohol y la acetona pueden debilitar la estructura del material de poliuretano. Comprobar el contenido de acetona y alcohol de los ingredientes de los preparados empleados en pulverizadores y torundas.
- Acetona: No usar acetona sobre la superficie de los catéteres. La acetona puede aplicarse a la piel, pero debe dejarse que se seque completamente antes de aplicar vendajes.
- Alcohol: No usar alcohol para poner en remojo la superficie de los catéteres o para desatascar catéteres. Debe prestarse sumo cuidado al instilar medicamentos que contengan altas concentraciones de alcohol. Dejar siempre que el alcohol se seque completamente antes de aplicar vendajes.
- 11. Precaución:** Algunos de los desinfectantes empleados en el sitio de inserción del catéter contienen disolventes que pueden dañar el material del catéter. Asegurarse de que el sitio de inserción esté seco antes del vendaje.
- 12. Precaución:** El uso de una jeringa de tamaño inferior a 10 ml para irrigar o despejar un catéter obstruido podrá provocar escapes intraluminales o la rotura del catéter.<sup>6</sup>
- Procedimiento sugerido:**  
**Utilizar una técnica estéril.**
- Precaución:** Colocar al paciente en posición de Trendelenburg hasta el punto tolerado a fin de reducir el riesgo de emboli gaseosa. Si se usa el método femoral, colocar al paciente en posición supina.
  - Preparar y cubrir el sitio de la punción, según se requiera.
  - Realizar una incisión cutánea con la aguja deseada (aguja de calibre 25 Ga. ó 22 Ga.).
  - Preparar el catéter para la inserción lavando la luz. Mantener el catéter abierto para permitir el paso de la guía de alambre. **Advertencia: No cortar el catéter para alterar su longitud.**
  - Localizar la vena central con una aguja de calibre 22 y una jeringa.
  - Insertar el conjunto introductor de catéter y aguja con la jeringa acoplada en la vena junto a la aguja localizadora y aspirar. Extraer la aguja localizadora. Retirar la aguja del catéter introductor. Si después de haber extraído la aguja no se observa un flujo libre de sangre venosa, acoplar la jeringa al catéter y aspirar hasta obtener un buen flujo de sangre venosa. **Precaución: El color de la sangre aspirada no es siempre una indicación fiable de acceso venoso.<sup>10</sup> No volver a insertar la aguja en el catéter introductor.** Debido al riesgo potencial de una colocación inadvertida en la arteria, deberá verificarse el acceso a la vena mediante una forma de onda producida por un transductor de presión calibrada (véase la Figura 2).
  - Si no se cuenta con equipo de control hemodinámico para permitir la transducción de una forma de onda de la vena central, desconectar la jeringa y comprobar si hay flujo pulsátil. Por lo general, el flujo pulsátil es una indicación de perforación inadvertida de la arteria.

**Técnica alternativa:**  
Como alternativa al conjunto de catéter y aguja puede utilizarse la aguja introductora de manera normal.

  - Insertar en la vena la punta deseada de la guía de alambre flexible a través de la aguja introductora o del catéter. Si se utiliza la parte de la guía de alambre flexible con la punta en "J", prepararla para la inserción deslizando el tubo de plástico sobre la punta en "J" para enderezarla. Hacer avanzar la guía de alambre flexible hasta la profundidad deseada de la manera acostumbrada. Para el avance de la punta en "J" puede requerirse un delicado movimiento rotatorio. **Advertencia: No cortar la guía de alambre flexible para alterar su longitud. A fin de minimizar el riesgo de cortar o dañar la guía de alambre flexible, extraerla con cuidado de que no roce contra el bisel de la aguja.**
  - Sostener la guía de alambre flexible en posición y extraer la aguja introductora o el catéter. **Precaución: Sujetar firmemente la guía de alambre flexible en todo momento.**
  - Ampliar el punto de incisión cutánea con el borde cortante del bisturi, colocado en sentido contrario a la guía de alambre flexible. **Precaución: No cortar la guía de alambre flexible.** Utilizar el dilatador de vasos para ampliar el sitio de la punción, según se requiera. **Advertencia: A fin de minimizar el riesgo de una posible perforación de la pared de los vasos, no dejar el dilatador de vasos colocado como si fuera un catéter permanente.**
  - Enhebrar la punta del catéter sobre la guía de alambre flexible. En el extremo del cubo del catéter debe quedar a la vista un trozo de guía de alambre de longitud suficiente como para poder mantenerla firmemente sujetada. Sujetando el catéter a ras de la piel, hacerlo avanzar en la vena con un ligero movimiento de torsión. **Precaución: En caso de que se suministren una pinza y un sujetador para el catéter, éstos no deben acoplarse al catéter hasta después de extraer la guía de alambre flexible.**
  - Hacer avanzar el catéter hasta su posición final permanente utilizando las marcas en centímetros (cuando se incluyan) como puntos de referencia para la colocación.
  - Sostener el catéter a la profundidad deseada y extraer la guía de alambre flexible. El catéter Arrow que se suministra junto con este producto ha sido diseñado para poderlo deslizar libremente sobre la guía de alambre flexible. Si se encontrase resistencia al tratar de extraer la guía de alambre flexible después de la colocación del catéter, puede que el alambre flexible esté doblado alrededor de la punta del catéter en el interior del vaso (véase la Figura 3).

En estas circunstancias, el tirar hacia atrás de la guía de alambre flexible puede suponer la aplicación de una fuerza indebida sobre la guía de alambre con la consiguiente rotura de la misma. Si se encuentra resistencia, retirar el catéter unos 2 ó 3 cm con respecto a la guía e intentar extraer esta última. Si se sigue encontrando resistencia, extraer simultáneamente la guía de alambre flexible y el catéter. **Advertencia: Aunque el índice de fallo de la guía de alambre flexible sea extremadamente bajo, el médico deberá tener presente el riesgo de roturas de la guía cuando se ejerce fuerza excesiva sobre el alambre.**  - Una vez extraída la guía, verificar que esté intacta.
  - Verificar la posición de la luz conectando una jeringa al catéter y aspirando hasta que se observe un flujo libre de sangre venosa. Conecte la línea tipo luer-lock adecuada, según sea necesario, o "cierre" a través del capuchón de inyección utilizando el protocolo estándar del hospital. Cuando se proporcione, se utiliza una pinza deslizante en la línea de extensión para impedir el flujo a través del catéter durante los cambios de líneas y de capuchones de inyección. **Precaución: a fin de minimizar el riesgo de dañar la línea de extensión por exceso de presión, es necesario abrir la pinza antes de infundir líquidos a través del catéter.**
  - Fijar firmemente el catéter y vendarlo provisionalmente.
  - Inmediatamente después de la colocación, confirmar la posición de la punta del catéter mediante radiografía del tórax. **Precaución: En el examen radiográfico el catéter debe**

**encontrarse en el lado derecho del mediastino en la vena cava superior con el extremo distal del catéter paralelo a la pared de la vena cava y su punta distal situada por encima de la vena ácigos o de la carina traqueal, según cuál de las dos se visualice mejor.** Si la punta del catéter se encuentra mal colocada, volverla a colocar y verificar de nuevo su posición.

17. Sujetar el catéter en posición en el paciente. Utilizar un anillo de sutura o alas laterales integrales como sitio de sutura primario. En los juegos donde se suministre, la pinza y el sujetador deben utilizarse como sitio de sutura secundario, según sea necesario. **Precaución: A fin de minimizar el riesgo de cortar o dañar el catéter, o impedir el flujo a través del mismo, no suturar directamente al diámetro exterior del catéter.**

**Instrucciones de uso de la pinza y del sujetador del catéter (cuando se suministre):**

- Después de haber extraído la guía de alambre flexible y de haber conectado o cerrado la línea, extender las alas de la pinza de goma y colocarla sobre el catéter, según se requiera, de forma que la punta quede colocada correctamente (véase la Figura 4).
  - Prender (se oirá un chasquido) el sujetador rígido a la pinza del catéter (véase la Figura 5).
  - Sujetar el catéter al paciente suturando la pinza y el sujetador a la piel, usando las alas laterales para reducir al mínimo el riesgo de migración del catéter (véase la Figura 6).
18. Vendar el sitio de la punción siguiendo el protocolo del hospital. **Precaución: Volver a vendar el sitio de inserción regular y meticulosamente empleando una técnica aséptica.**
19. Anotar en el gráfico del paciente la longitud del catéter permanente utilizando las marcas en centímetros (cuando se incluyan) en el punto en que el catéter entra en la piel. Es necesario volver a verificar con frecuencia dichas marcas para comprobar que el catéter no se ha movido.
20. En los juegos donde se suministre, se puede utilizar una pajita filtrante para extraer medicamentos de las ampollas abiertas.

**Procedimiento para el cambio del catéter:**

1. Utilizar una técnica estéril.
2. **Precaución: Antes de intentar cambiar el catéter, retirar, si los hay, la pinza y el sujetador del catéter.**
3. Proceder según el protocolo del hospital. No se recomienda cortar el catéter debido al posible riesgo de embolia a causa del catéter.

**Procedimiento para la extracción del catéter:**

1. **Precaución: Colocar al paciente en posición supina.**
2. Retirar el vendaje. **Precaución: A fin de reducir al mínimo el riesgo de cortar el catéter, no emplear tijeras para retirar el vendaje.**
3. **Advertencia: La exposición de la vena central a la presión atmosférica puede provocar la entrada de aire en el sistema venoso central.** Quitar los puntos de sutura de la pinza del catéter (cuando ésta se suministre) y del sitio de sutura primaria. Tener cuidado de no cortar el catéter. Extraer lentamente el catéter, tirando de él paralelamente a la piel. A medida que el catéter va saliendo, presionar con un vendaje impermeable al aire, por ejemplo, una gasa impregnada de VASELINE. Puesto que el rastro residual del catéter queda como punto de entrada de aire hasta que se cierra por completo, el vendaje oclusivo deberá dejarse en posición durante un mínimo de 24 a 72 horas, según el período de tiempo que el catéter haya permanecido en el sitio.<sup>11,14,16,19</sup>
4. Una vez extraído el catéter, inspeccionarlo para asegurarse de que se ha retirado completamente.
5. Registrar el procedimiento de extracción.

Arrow International, Inc. recomienda que el usuario se familiarice con el material bibliográfico.

\*En caso de tener alguna pregunta o si desea obtener información bibliográfica adicional, póngase en contacto con Arrow International, Inc.

## Enkanalig kateter för central ven

### Säkerhet och verkan:

Använd ej om förpackningen har öppnats vid ett tidigare tillfälle eller om den är skadad. **Varning:** Läs före användning varningar, viktiga påpekanter och anvisningar i bipacksedeln. Underlätenhet att läsa dessa kan eventuellt resultera i allvarlig patientskada eller dödsfall.

Modifera aldrig katatern, fjäderträdsledaren eller någon annan sats/setkomponent under införing, användning eller avlägsnande.

Förarandet måste utföras av utbildad personal, väl bevädrad i anatomiska riktpunkter, säker teknik och eventuella komplikationer.

**Varning:** Placerar aldrig katatern i eller låt den aldrig sitta kvar i höger förmak eller höger kammar (se Fig. 1).

### Hjärttampaponad:

Många författare har dokumenterat att placering av kvarkatetrar i höger förmak är ett mycket riskfyllt förfarande.<sup>1,2,3,5,7,13,15</sup> som kan leda till perforation och tamponad av hjärtat.<sup>1,2,3,5,13,15</sup> Även om hjärttamponad sekundärt till hjärtäcksutgjutning är ovanlig, finns det en hög mortalitet associerad med denna komplikation.<sup>17</sup> Läkare som placarer centrala venkatetrar måste vara medvetna om denna potentiellt fatala komplikation innan katatern matas in alltför långt med hänsyn till patientens kroppsstorlek.

Ingen speciell införingsväg eller katetertyp är undantagen från den här potentiellt fatala komplikationen.<sup>15</sup> Kvarkateterspetsens verkliga position bör bekräftas medelst röntgenundersökning efter införandet.<sup>1,2,5,13,15,18</sup> Centrala venkatetrar bör placeras i övre hälvenen<sup>1,2,3,5,7,13,20</sup> alldeles ovanför dess förenning med höger förmak och parallellt med kärlväggen<sup>9,20</sup> så att deras distala spets ligger precis ovanför venaazygos eller carina trachealis, om denna bättre kan visualiseras.

Centrala venkatetrar bör ej placeras i höger förmak, såvida detta ej krävs för speciella, kortvariga förändringar, t. ex. aspiration av luftemboli under neurokirurgi. Dessa förändringar är dock riskfydda och måste noga övervakas och kontrolleras.

### Indikationer för användning:

Den enkanaliga katatern möjliggör ventillträde till det centrala blodomloppet.

### Kontraindikationer:

Inga kända.

### Varningar och Viktigt:\*

1. **Varning:** Steril, avsedd för engångsbruk: Får inte återanvändas, ombearbetas eller omsteriliseras. Återanvändning av produkten medför en potentiell risk för allvarlig skada och/eller infektion som kan leda till dödsfall.
2. **Varning:** Placerar aldrig katatern i eller låt den aldrig sitta kvar i höger förmak eller höger kammar. Centrala venkatetrar skall placeras så att kataterna distala spets befinner sig i den övre hälvenen (vena cava superior, VCS) alldeles ovanför

föreningen mellan VCS och höger förmak och parallellt med kärlväggen. Vid införing via vena femoralis skall katatern foras in i käletet så att kateterspetsen ligger parallellt med kärlväggen och ej inträder i höger förmak.

3. **Varning:** Läkare måste vara medvetna om eventuella komplikationer associerade med centrala venkatetrar inklusive hjärttamponad sekundärt till kärlväggs-, förmaks- eller ventrikelperforation, pleurala och mediastinala skador, luftembolism, kateterembolism, laceration av ductus thoracicus, bakteriemti, sepsis, tromb, oavsnittlig artärpunktion, nervskada, hematom, blödning och rytmrubbnningar.
4. **Varning:** Använd ej onödig kraft när trädledaren eller katetarer avlägsnas. Om avlägsmandet ej kan utföras på ett lätt sätt, bör bröströntgen göras och vidare konsultation begäras.
5. **Varning:** Läkare måste vara medveten om risken för luftembolism i samband med kvarlämmandet av öppna nälar eller katetrar i centrala venösa punkturer eller som en konsekvens av oavsnittlig isärkoppling. Minsk risken för isärkoppling genom att endast använda ordentligt åtdragna Luer-låslösningar med denna anordning. Följ sjukhusets rutiner för allt kateterunderhåll som skydd mot luftembolism.
6. **Varning:** Införing av fjäderträdsledaren i högra delen av hjärtat kan orsaka rytmrubbnning, högersidigt grenblock,<sup>8</sup> samt kärlväggs-, förmaks- eller ventrikelperforation.
7. **Varning:** På grund av risken för HIV (humant immunosuppressivt virus) eller andra blodburna patogena organismer bör sjukvärdspersonal rutinmässigt vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder vid kontakt med blod och andra kroppsvätskor vid vård av alla typer av patienter.
8. **Viktigt:** Kvarkatetrar måste inspekteras rutinmässigt med avseende på önskad flödeshastighet, förbands säkerhet, korrekt placering av katatern och åtdrägen Luer-låslösning. Använd centimeter-markeringarna för att kontrollera om kataterna liggande ändratis.
9. **Viktigt:** Endast röntgenundersökning av kataterns placering kan garantera att kataterna spets ej har inträtt i hjärtat eller att den ligger parallellt med kärlväggen. Om kataterna liggande har ändrats, utför bröströntgen omedelbart för att bekräfta kateterspetsens liggande.
10. **Viktigt:** Alkohol och aceton kan försvaga strukturen hos polyuretanmaterial. Kontrollera aceton- och alkoholinnehållet i preparations-sprayer och -torkar. Aceton: Använd inte aceton på kataterna yta. Aceton kan appliceras på huden men måste få torka helt innan förband läggs på.
- Alkohol: Använd inte alkohol för att blötläggja kataterna yta eller för att renna lumen. Utöva försiktighet vid instillation av läkemedel som innehåller alkohol i hög koncentration. Låt alltid alkoholen torka fullständigt innan förband läggs på.
11. **Viktigt:** Vissa desinficeringsmedel som används vid kataterns införingsställe innehåller lösningsmedel som kan angripa katetermaterialet. Se till att införingsstället är torrt innan förband läggs på.

- 12. Viktigt: Om en spruta som är mindre än 10 ml används för att spola eller lösa upp koagel i en ockluderad kateter kan detta leda till intraluminalt läckage eller kateterbristning.<sup>6</sup>**

## Förslag till arbetsgång:

### Använd steril teknik.

- 1. Viktigt: Placerä patienten i ett bekvämt Trendelenburg-läge för att minska risken för luftembolisering. Vid införing via vena femoralis placeras patienten i ryggläge.<sup>6</sup>**

2. Förbered och sterilkläd runt insticksstället efter behov.
3. Strimma huden med önskad nål (25 Ga. eller 22 Ga. nål).
4. Förbered katatern för införande genom att spola ur kanalen. Lämna katatern öppen för införing av trådledare. **Varning: Kapa aldrig katatern för att ändra dess längd.**
5. Lokalisera den centrala venen med en 22 Ga. nål och spruta.
6. För in införarkatatern/nålen med vidhängande spruta i venen på sidan om lokaliseringssnålen och aspirera. Avlägsna lokaliseringssnålen. Dra ut nälen från införarkatatern. Om inget fröt flöde av venblod kan iakttas efter det att nälen har avlägsnats, koppla en spruta till katatern och aspirera tills ett ymnigt flöde av venblod har etablerats. **Viktigt: Färger på det aspirerade blodet är inte alltid en pålitlig indikator för intrång i en ven.<sup>10</sup> För ej i nälen på nytt i introducerkatatern.** På grund av potentiell risk för oavsiktlig arteriell placering bör ventillätra venifieras med en tryckkurva från en kalibrerad tryckgivare (se Fig. 2).
- Om hemodynamisk mätutrustning ej finns tillgänglig för att visa att tryckkurvan kommer från en central ven, koppla loss sprutan och kontrollera om flödet pulsar. Pulserande flöde är vanligen en indikator på oavsiktlig arteriell punktion.
- Alternativ metod:**  
En införarnål kan användas på normalt sätt som ett alternativ till en kateter/nålenhet.
7. För in önskad spets på fjädertrådsledaren genom införarnålen eller katatern i i venen. Om fjädertrådsledarens "J"-spets används, förbered införingen genom att dra plaströret över "J"-spetsen för att rätta ut den. Fjädertrådsledaren matas sedan in på vanligt sätt till lämpligt djup. Införing av "J"-spetsen kan kräva en försiktig, roterande rörelse. **Varning: Kapa aldrig ledaren för att färrkora den. Dra aldrig tillbaka ledaren mot nälens fasning för att minska risken för skada eller brott på fjädertrådsledaren.**
8. Håll fjädertrådsledaren på plats och avlägsna införarnålen eller katatern. **Viktigt: Håll hela tiden ett stadigt grepp om fjädertrådsledaren.**
9. Utvrida punktionsstället med en skalpell. Se till att egggen riktas bort ifrån fjädertrådsledaren. **Viktigt: Skär ej av trådledaren.** Använd en kärldilatator för att utvrida efter behov. **Varning: Lämna aldrig en kärldilatator på plats som en kvarkateter för att undvika eventuell kärliäggsperforation.**
10. Trä spetsen på den katatern över fjädertrådsledaren. Tillräckligt mycket av ledaren måste finnas kvar utanför kateterfattningen för att bibehålla ett stadigt grepp om fjädertrådsledaren. Fatta tag nära huden och för in katatern i venen med en lätt vriderörelse. **Viktigt: Kateterklämma och fäste, om sådana ingår, får ej fästas på katatern förrän fjädertrådsledaren har avlägsnats.**
11. Skjut fram katatern till dess slutliga varliggivande läge med hjälp av centimetermarkeringarna (om sådana finns) som referenspunkter för placering.
12. Håll katatern på lämpligt djup och avlägsna fjädertrådsledaren. Arrow-katatern som levereras med produkten är konstruerad för att fritt kunna passera över fjädertrådsledaren. Om motstånd avkänns vid avlägsnandet av fjädertrådsledaren

efter det att katatern har placerats, kan ledaren vara snodd om kateterspetsen i kårellet (se Fig. 3).

I sådana fall kan tillbakadragande av fjädertrådsledaren resultera i en stor påfrestning så att trådledaren brister. Vid motstånd dras katatern cirka 2 till 3 cm bakåt i relation till fjädertrådsledaren. Gör därefter ett nytt försök att avlägsna fjädertrådsledaren. Om motstånd fortfarande avkänns måste ledaren och katatern avlägsnas samtidigt. **Varning: Även om risken för att fjädertrådsledaren skall brista är ytterst liten, bör läkaren vara medveten om att brott kan förekomma om alltför mycket kraft anbringas på tråden.**

13. Kontrollera att hela fjädertrådsledaren är oskadad vid avlägsnandet.
14. Kontrollera lumenplaceringen genom att ansluta en spruta till katatern och aspirera tills ett fritt venblodflöde observeras. Anslut efter behov tillämplig slang med Luerläs, eller "lös" med ett injektionslock enligt normal sjukhusrutin. En skjutklämma, om sådan ingår, används på förlängningsslangen för att blockera flödet genom katatern under byte av slang eller injektionslock. **Viktigt: För att minimera risken för att förlängningsslanger skadas av onödig härt tryck måste klämman öppnas före infusion genom ifrågavarande lumen.**
15. Fäst katatern och sätt på förband temporärt.
16. Bekräftra kateterspetsens placering med hjälp av bröströntgen omedelbart efter införandet. **Viktigt: Röntgenundersökningen måste utvisa att katatern befinner sig på höger sida av mediastinum i den övre hälvenen med den distala änden på katatern parallellt med vena cava-väggen och den distala spetsen placerad ovanför antingen den azygotiska venen eller kälven på luftrutpen, beroende på vilken som syns bäst. Om kateterspetsen ligger i fel position måste den omplaceras och en ny kontroll utföras.**
17. Fäst katatern på patienten. Använd den inbyggda suturringen och/eller sidovringarna som det primära suturstället. I satser där en kateterklämma och fäste ingår kan dessa användas som ett sekundärt suturställe vid behov. **Viktigt: Suturera ej direkt på katatern ytter omkrets för att undvika att klippa av eller skada katatern eller att hämma flödet.**
- Bruksanvisning för kateterklämma och fäste (i tillämpliga fall):**
- Efter att fjädertrådsledaren avlägsnats och nödvändiga slangen blivit anslutna eller tillslutna efter behov öppnas gummiklämman käftar och placeras på katatern så att spetsen säkert ligger på rätt plats (se Fig. 4).
  - Knäp fast det styva fästet på kateterklämmen (se Fig. 5).
  - Fäst katatern på patienten genom att suturera kateterklämman och fästet på huden, med användning av sidovringarna för att minska risken för att katatern börjar migrera (se Fig. 6).
18. Sätt på lämpligt förband enligt sjukhusets rutiner. **Viktigt: Sköt om insticksstället genom regelbundet och noggrant byte för förband med aseptisk metod.**
19. Anteckna i patientens journal hur långt kvarkatatern befinner sig utanför insticksstället med användning av centimetermarkeringarna (om sådana finns) på katatern där den går in genom huden. Inspektera regelbundet för att kontrollera att katatern ej har flyttats.
20. I satser där ett filtersugrör ingår kan det användas för att suga ut läkemedel från öppnade ampuller.
- Procedur för kateterbyte:**
- Använd steril teknik.
  - Viktigt: Avlägsna kateterklämma och fäste om sådana ingår innan ett kateterutbyte påbörjas.**

3. Följ sjukhusets rutiner. Vi rekommenderar inte att katetern kapas på grund av risk för kateterembolism.

### **Avlägsnande av katetern:**

1. **Viktigt: Placera patienten i ryggläge.**
2. Ta bort förband. **Viktigt: Minska risken för att klippa av katetern genom att inte använda sax för att ta bort förbandet.**
3. **Varning: Om den centrala venen utsätts för atmosfärtryck kan detta medföra att luft tränger in i det centrala vensystemet.** Avlägsna sutur (eller sutureer) från kateterklämmarna (om sådan ingår) och det primära suturområdet. Var försiktig så att du inte klipper av katetern. Avlägsna långsamt katetern genom att dra den parallellt med huden. Alt eftersom katetern dras ut appliceras ett tryck med ett lufttätt bandage t. ex. gasbinda med VASELINE. Eftersom luft kan komma in genom såröppningen efter katetern tills den helt tillslutits, måste ett ocklusivt bandage lämnas på plats under minst 24-72 timmar, beroende på hur länge katetern var kvarliggande.<sup>11,14,16,19</sup>
4. Inspektera katetern efter uttagningen för att vara säker på att dess hela längd kom ut.
5. Journalsför uttagningen.

Arrow International, Inc. rekommenderar att användaren studerar referenslitteraturen.

\*Om du har frågor eller önskar ytterligare referensinformation, kontakta Arrow International, Inc.



# Tek Lümenli Santral Venöz Kateterizasyon Ürünü

## Güvenlik ve Etkinlik Hususları:

**Ambalaj** daha önce açılmış veya hasarlıysa kullanmayın. **Uyarı:** Kullanımından önce prospektüsdeki tüm uyarıları, önlemleri ve talimatı okuyun. Aksi halde hastanın ciddi şekilde zarar görmesine veya ölümüne neden olabilir.

Kateter, yaylı kılavuz tel veya başka herhangi bir kit/set bileşenini insersiyon, kullanım veya çıkışma sırasında modifiye etmeyin.

İşlem anatomik yer işaretleri, güvenli teknik ve potansiyel komplikasyonlar konusunda deneyimli bir eğitimi personel tarafından gerçekleştirilmelidir.

**Uyarı:** Kateteri sağ atriyum veya sağ ventrikülé yerleştirmeyin ve buralarda kalmasına izin vermeyin (bakınız Şekil 1).

### Kardiyak Tamponad:

Birçok yazar kalıcı kateterlerin sağ atriyuma yerleştirilmesinin kardiyak perforasyon ve tamponada neden olabilecek tehliki bir uygulama olduğunu<sup>1,2,3,5,7,13,15</sup> belgelendirmiştir.<sup>1,2,3,5,13,15</sup> Perikardiyal efuziyona sekonder kardiyak tamponad nadir olsa da bunuluları yüksek bir mortalite oranı vardır.<sup>17</sup> Santral venöz kateterler yerleştirengi uygulayıcıları kateteri hasta cüssesine göre çok fazla ilerletmeden bu ölümcül olabilecek komplikasyondan haberدار olmalıdır.

Hicbir belirli yol veya kateter tipi bu ölümcül olabilecek komplikasyondan muaf değildir.<sup>15</sup> Kalıcı kateterin ucunun fiili pozisyonu insersiyon sonrasında röntgenle doğrulanmalıdır.<sup>1,2,5,13,15,18</sup> Santral venöz kateterler superior vena cava'yaya<sup>1,2,3,5,7,13,20</sup> sağ atriyuma bileskesinin üstünden ve damar duvarına<sup>9,20</sup> paralel olarak ve distal uç hangisi daha iyi görünteleniyorsa azigos veninin veya traekanın karinasi tizerinde bir seviyede konumlandırılmalı olarak yerleştirilmelidir.

Santral venöz kateterler sağ atriyuma nörocerrahi sırasında hava emboliszi aspirasyon gibi nispeten kısa süreli özel işlemler için spesifik olarak gerekmektede yerleştirilmelidir. Bu tür işlemler yine de riske yatkındır ve yakından izlenmesi ve kontrol edilmesi gereklidir.

## Kullanma Endikasyonları:

Tek lümenli kateter santral dolasına venöz erişimi mümkün kılınır.

## Kontrendikasyonlar:

Bilinen yoktur.

## Uyarılar ve Önlemler:\*

**1. Uyarı:** Steril, Tek kullanımlık: Tekrar kullanılmayın, tekrar işleme koymayın veya tekrar sterilize etmeyein. Cihazın tekrar kullanılması ölümüne neden olabilecek ciddi yaralanma ve/veya enfeksiyon riski potansiyeli oluşturur.

**2. Uyarı:** Kateteri sağ atriyum veya sağ ventrikülé yerleştirmeyin ve buralarda kalmasına izin vermeyin. Santral venöz kateterleri kateterin distal ucu superior vena cava'nnı (SVC) içinde ve SVC ile sağ atriyum bileskesinin üzerinde yer alıp damar duvarına paralel olarak uzanacak şekilde konumlandırılmalıdır. Femoral ven yakalama için kateter damar içine kateter ucu damar duvarına paralel

uzanacak ve sağ atriyuma girmeyecek şekilde ilerletilmelidir.

3. **Uyarı:** Uygulayıcılar santral ven kateterleriyle ilişkili olarak damar duvari, atriyum veya ventrikül perforasyonuna sekonder kardiyak tamponad, pleural ve mediastinal yaralama malar, hava emboliszi, kateter emboliszi, duktus torasikus laserasyonu, bakteriyemi, septisemi, tromboz, istemden arteriyel ponksiyon, sinir hasarı, hematoma, kanama, ve disritmiler gibi komplikasyonların farkında olmalıdır.
4. **Uyarı:** Kılavuz tel veya kateterleri çıkarırken aşırı güç uygulamayın. Geri çekme kolayca yapılmamıştır bir göğüs film çekilmeli ve ek konsültasyon istenmelidir.
5. **Uyarı:** Uygulayıcı santral venöz ponksiyon bölgelerinde açık ığneler veya kateterler bırakmak ile ilişkili veya istenmeden ayırmaların bir sonucu olarak olsası hava embolisinden haberdar olmalıdır. Ayırılma risklerinin minimuma indirmek üzere bu cihazla sadece güvenli bir şekilde sıkıştırılmış Luer Lock bağlantıları kullanılmalıdır. Hava embolisine karşı koruma açısından tüm kateter bakımı için hastane protokolünü izleyin.
6. **Uyarı:** Kılavuz telin sağ kalbe geçirilmesi disritmiler, sağ da bloğu<sup>a</sup> ve damar duvarı, atriyum veya ventrikül perforasyonuna neden olabilir.
7. **Uyarı:** HIV (İnsan İmmünyetmezlik Virüsü) veya kanla taşınan diğer patojenlere maruz kalma riski nedeniyle sağlık bakımı çalışanları tüm hastaların bakımı sırasında evrensel kan ve vücut sıvısı örneklerini rutin olarak kullanmalıdır.
8. **Önlem:** Kalıcı kateterler istenen akış hızı, pansummanın sağlamlığı, doğru kateter pozisyonu ve güvenli Luer Lock bağlantılarından rutin olarak incelemelidir. Kateter pozisyonunun değişip değişmediğini tanımlamak için santimetre işaretlerini kullanın.
9. **Önlem:** Kateter ucunun kalbe girdiğini veya artuk damar duvarına paralel bulunmadığını sadece kateter yerleştirilmenin röntgenin incelemesi doğrulayabilir. Kateter pozisyonu değiştiye hemen kateter ucu pozisyonunu doğrulamak için göğüs röntgen incelemesi yapın.
10. **Önlem:** Alkol ve aseton, polüüretan materyallerin yapısını zayıflatırlar. Hazırlık spreyleri ve mendillerinin içindekileri aseton ve alkol içeriği açısından kontrol edin.
- Aseton:** Kateter üzerinde aseton kullanmayın. Aseton cilde uygulanabilir ama pansum an uygulanmadan önce tamamen kurumasını beklemelidir.
- Alkol:** Kateter yüzeyini alkole batırmayın veya kateteri tekrar açmak için alkol kullanmayın. Yüksek konsantrasyonda alkol içeren ilaçlar uygularken dikkatli olunmalıdır. Pansum an uygulanmadan önce daima alkolün tamamen kurumasını bekleyin.
11. **Önlem:** Kateter insersiyon bölgesinde kullanılan bazı defektanlar kateter materyaline saldırılabilen solventler içerir. Pansum an uygulanmadan önce insersiyon bölgesinin kuru olması sağlanır.
12. **Önlem:** Tıkalı bir kateteri yıkamak veya piştiyi gidermek üzere 10 ml altında bir sırınga kullanılması intraluminal sıvınızı veya kateter rüptürüne neden olabilir.<sup>6</sup>

## **Önerilen Bir İşlem: Steril teknik kullanın.**

1. **Önlem:** Hava embolisi riskini azaltmak üzere toler edildiği şekilde hastayı hafif Trendelenburg pozisyonuna koyn. Femoral yaklaşım kullanılırsa hastayı sırt üstü pozisyonuna koyn.
2. Ponksiyon bölgesini gerektiği şekilde hazırlayın ve örtün.
3. İstenen iğneyle (25 G veya 22 G iğne) ciltte bir kabarlık oluşturun.
4. Kateteri lümenden sıvı geçirerek insersiyona hazırlayın. Kateteri kılavuz tel geçmesi için kapaklı takılmamış durumda bırakın. **Uyarı:** Kateteri uzunluğunu değiştirmek üzere kesmeyin.
5. Santral veni 22 G iğne ve şırıngayla bulun.
6. İntrodüsör kateter/iğneyi takılı şırıngayla yer bulucu iğne yanında ven içine yerleştirin ve aspirasyon yapın. Yer bulucu iğneyi çıkarın. İğneyi introdüsör kateterden çıkarın. İğne çıkarıldıkten sonra venöz kanın serbestçe aktığı şırıngayı kateteri takın ve iyi venöz kan akışı elde edilinceye kadar aspirasyon yapın. **Önlem:** Aspire edilen kanın rengi venöz erişim açısından her zaman iyi bir göstergesi değildir.<sup>10</sup> İğneyi tekrar introdüsör kateterde yerlesirmeyin. İstemeden arteriel yerleştirme potansiyeli nedeniyle kalibre edilmiş bir basınç transdüsürüle elde edilen bir dalgaformıyla venöz erişimi doğrulayın (bakınız Şekil 2).
- Bir santral venöz dalgaformunu transdüksiyonu mümkün kılmak üzere hemodinamik izleme ekipmanı yoksa şırıngayı çıkarın ve pulsatil akış kontrolü yapın. Pulsatil akış genellikle istenmedik arter ponksiyonuna işaret eder.
- Alternatif Teknik:**  
İntrodüsör iğne kateter/iğne tertibatına alternatif olarak standart şekilde kullanılabilir.
7. Yayılı kılavuz telin istenen ucunu introdüsör iğne veya kateter içinden vene yerleştirin. Yayılı kılavuz telin "J" uç kısmını külâmihâyoza plastik tüpü düzeltmek üzere "J" üzerinde kaydırılarak insersiyona hazırlayın. Yayılı kılavuz tel sonra istenen derinlikte kadar rutin şekilde ilerletilmelidir. "J" uçları iterlerken hafif rotasyon hareketi gereklidir. **Uyarı:** Yayılı kılavuz teli uzunluğunu değiştirmek üzere kesmeyin. Yayah kılavuz teli içinden eğimli kısmı üzerine yaylı kılavuz telin kesilmesi ve zarar görmesi olasılığı riskini en aza indirmek üzere çekmeyin.
8. Yaylı kılavuz teli yerinde tutun ve introdüsör iğneyi veya kateteri çıkarın. **Önlem:** Yayah kılavuz teli daima sıkıca tutun.
9. Kütanöz ponksiyon bölgesini bistürünün kesici ucu yaylı kılavuz telden üzüne doğru konumlandırmış olarak bütüttün. **Önlem:** Kılavuz teli kesmeyin. Böylece gerektiği şekilde bütütmek için damar dilatörünü kullanın. **Uyarı:** Olası damar duvarı perforasyonunu en aza indirmek için damar dilatörü kahci bir kateter olarak yerinde bırakmayın.
10. Kateterin ucunu yaylı kılavuz tel üzerinden geçirin. Kateterin göbek kısmında kılavuz teli sıkıca tutmayı yetecek kılavuz tel uzunluğu açıktı kalmalıdır. Cilde yakın tutarken kateteri ven içine hafif çevirin haretkeş ilerletin. **Önlem:** Sağlandırdığında kateter klempli ve tutturucusu yaylı kılavuz tel çırılçınlaya kadar kateterde takılmamalıdır.
11. Kateteri son kalıcı pozisyonuna santimetre işaretlerini (sağlandırmışsa) konumlandırma referans noktalarını olarak kulanarak ilerletin.

12. Kateteri istenen derinlikte tutun ve yaylı kılavuz teli çıkarın. Bu türünde sağlanan Arrow kateteri yaylı kılavuz teli üzerinden serbestçe geçecek şekilde tasarlanmıştır. Yaylı kılavuz teli kateter yerleştirildiğinden sonra çıkarırken dirençle karşılaşılırsa yaylı tel damar içinde kateter ucu etrafında bükülmüş olabilir (bakınız Şekil 3).

Bu durumda yaylı kılavuz teli geri çekmek gereksiz güç uygulamasına neden olabilir ve yaylı kılavuz teli kırılmasına yol açabilir. Dirençle karşılaşılırsa kateteri yaylı kılavuz tele göre yaklaşık 2-3 cm geri çekin ve yaylı kılavuz teli çıkarmaya çalışın. Yine dirençle karşılaşılırsa yaylı kılavuz tel ve kateterini birlikte çıkarın. **Uyarı:** Yaylı kılavuz tel arazası insidansı çok düşük olsa da uygulayıcı tele gereksiz güç uygulanırsa kırılma potansiyelinden haberدار olmalıdır.

13. Tüm yaylı kılavuz telin çıkarıldığından sağlam olduğunu doğrulayın.

14. Lümen yerleştirimey katetere bir şırınga takip venöz kanın serbestçe aktığı izlenene kadar aspire ederek kontrol edin. Gerekliği şekilde uygun Luer Lock hattı takın veya standart hastane protokolüne kullanarak enjeksiyon kapaklı içinden "külit" oluşturun. Sağlandırdığında kaydırıcı klempli, hat ve enjeksiyon kapaklı değişiklikleri sırasında kateter içindeki akış takıma için uzatma hattında kullanılır. **Önlem:** Asırı basıncın uzatma hattının hasar görmesi riskini minimuma indirmek üzere klempli kateter içinden infüzyon yapmadan önce açılmalıdır.

15. Kateteri geçici olarak sabitleyin ve pansuman yapın.

16. Kateter ucu pozisyonunu yerleştirmeden hemen sonra göğüs filmiley doğrulayın. **Önlem:** Röntgen filmi kateterin mediastinum sağ tarafında SVC içinde, kateterin distal ucu vena cava duvaruna paralel ve distal ucu hangisi daha iyi görüntülenmeye azıgıs veni veya trakeanın karınmasını üzerinde bir düzeye konumlanmış olarak göstervelidir. Kateter ucu yanlış konumlandırmışa tekrar konumlandırılır tekrar doğrulayın.

17. Kateteri hastaya sabitleyin. Primer sütür bölge olara entegre sütür halkası ve/veya yan kanatları kullanın. Sağlandırdığı kitlerde kateter klempli ve tutturucu gereklise sekonder sütür bölge olara kullanılmışlardır. **Önlem:** Kateteri kesme veya zarar verme veya kateter akışını engelleme riskini en aza indirmek üzere doğrudan kateterin dış kısmına sütür yerleştirmeyin.

### **Kateter Klempli ve Tutturucusu (sağlandırdığında)**

#### **Kullanma Talimatı:**

- Yaylı kılavuz tel çırıltıhp hat bağlandıktan veya kilitlidikten sonra lastik klempli kanatlarını açın ve uygun uç konumunu temin etmek için gerekligi şekilde kateter üzerinde konumlandırın (bakınız Şekil 4).
- Sert tutturucuya kateter klempline tıkkılatarak oturtun (bakınız Şekil 5).
- Kateteri hastaya kateter klempli ve tutturucuya birlikte cilde, kateter göçmesini minimuma indirmek üzere yan kanatları kullanarak sütür koyarak sabitleyin (bakınız Şekil 6).
- 18. Ponksiyon bölgесine hastane protokolune göre pansuman uygulayın. **Önlem:** İnsersiyon bölgесini aseptik teknik kullanarak düzenli ve dikkatli tekrar pansumanlarla izleyin.
- 19. Hastanın dosyasına kalıcı kateter uzunluğunu cilde girdiği yerde kateterdeki santimetre işaretlerine (sağlandırmışsa) göre yazın. Kateterin hareket etmediğinden emin olmak için sık sık görülür degerlendirme yapılmalıdır.
- 20. Sağlandırdığında kitlerde, açılmış ampüllerden ilaç çekmek için bir filtreli kâmiş kullanılabilir.

### **Kateter Değiştirme İşlemi:**

1. Steril teknik kullanın.
2. **Önlem:** Bir kateter değiştirme işlemine kalkışmadan sağlanmışsa önce kateter klempi ve tutturucuyu çıkarın.
3. Hastane protokolüne göre ilerleyin. Kateteri kesmek kateter embolisi potansiyeli nedeniyle önerilmez.

### **Kateter Çıkarma İşlemi:**

1. **Önlem:** Hastayı sırt üstü pozisyon'a koyn.

2. Pansumanı çıkarın. **Önlem:** Kateteri kesme riskini en aza indirmek için pansumanı çıkarmak üzere makas kullanmayın.
3. **Uyarı:** Santral venin atmosferik basıncı maruz kalması santral venöz sisteme hava girmesine neden olabilir. Sütür/ sütürleri kateter klemplinden (sağlanmışsa) ve primer sütür

bölgesinden çıkarın. Kateteri kesmemeye dikkat edin. Kateteri yavaşça, cilde paralel çekerek çıkarın. Kateter bölgeden çıkarken örn. VASELINE gazlı bez gibi hava geçirmeye bir pansumanla basınç uygulayın. Kalan kateter kanalı tamamen kapanıncaya kadar bir hava giriş noktası olarak görev gördüğünden oklitiziv pansuman kateterin kaldığı süreye bağlı olarak en az 24-72 saat yerinde kalmalıdır.<sup>11,14,16,19</sup>

4. Kateter çıkarıldığında tüm uzunluğun geri çekildiğinden emin olmak için inceleyin.
  5. Çıkarma işlemini belgeleyin.
- Arrow International, Inc. kullanımının referans literatüre aşina olmasını önerir.
- \*Sorularınız varsa veya ek referans bilgisi isterseniz lütfen Arrow International, Inc. ile irtibat kurun.





<b>EN</b>	Caution	Do not reuse	Do not sterilize	Sterilized by ethylene oxide	Do not use if package is damaged	Does not contain natural rubber latex	Consult instructions for use	Manufacturer	Use by
<b>FR</b>	Mise en garde	Ne pas réutiliser	Ne pas restériliser	Stérilisé à l'oxyde d'éthylène	Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé	Ne contient pas de latex de caoutchouc naturel	Consulter le mode d'emploi	Fabricant	Utiliser jusqu'à
<b>DE</b>	Achtung	Nicht wiederver- wenden	Nicht resterilisieren	Mit Ethylenoxid sterilisiert	Nicht verwen- den, wenn die Packung beschädigt ist	Enthält keinen Natur- kautschuklatex	Gebrauch- sanweisungen beachten	Hersteller	Halt- barkeits- datum
<b>IT</b>	Attenzione	Non riutiliz- zare	Non risteriliz- zare	Sterilizzato con ossido di etilene	Non utilizzare se la confezione è danneggiata	Non contiene gomma in lat- tice naturale	Consultare le istruzioni per l'uso	Fabbricante	Da utilizzare entro
<b>PL</b>	Przestroga	Nie używać ponownie	Nie sterylizować ponownie	Sterylizowano tlenkiem etylenu	Nie stosować, jeśli opakowanie jest uszkodzone	Nie zawiera naturalnego lateksu kauzu- kowego	Sprawdzić w instrukcji użycia	Wytwarzca	Zużyć do
<b>PT</b>	Cuidado	Não reutilizar	Não reesterilizar	Esterilizado por óxido de etileno	Não utilizar se a embalagem es- tiver danificada	Não contém látex de borracha natural	Consultar as instruções de utilização	Fabricante	Usar até
<b>RU</b>	Предупре- ждение	Повторно не использовать	Повторно не стерилизовать	Стерилизован этаноксидом	Не использовать, если упаковка повреждена	Не содержит натурального латекса	Смотрите инструкции по применению	Изготовитель	Срок годности
<b>SL</b>	Pre- vidnostno obvestilo	Ne uporabiti ponovno	Ne sterilizirati ponovno	Sterilizirano z etilen oksidom	Ne uporabite, če je ovajnina poškodovana	Ne vsebuje kavčuka iz nar- avnega lateksa	Glejte navodila za uporabo	Proizvajalec	Uporabno do
<b>ES</b>	Precaución	No reutilizar	No reester- ilizar	Esterilizado mediante óxido de etileno	No utilizar si el envase está dañado	No contiene látex de caucho natural	Consulte las instrucciones de uso	Fabricante	Fecha de caducidad
<b>SV</b>	Var försiktig	Får inte återan- vändas	Får inte omsteril- iseras	Steriliserad med etylennoxid	Får inte användas om förpackningen skadats	Innehåller inte naturlig gummilatex	Se bruksan- visning	Tillverkare	Använts före
<b>TR</b>	Dikkat	Tekrar kullanmayın	Tekrar sterili- ze etmeyin	Etilen oksit ile sterilize edilmişdir	Paket hasarlıysa kullanmayın	Doğal kauçuk lateks içermez	Kullanma talimatına bakınız	Üretici	Son kullanma tarihi



**EC REP** Teleflex Medical  
IDA Business and Technology Park  
Athlone, Ireland

S-04300-113A (9/11)

**ARROW**  
INTERNATIONAL  
2400 Bernville Road  
Reading, PA 19605 USA  
1-800-523-8446 | 1-610-378-0131